



# **PRODOTTI GLIDESCOPE E GLIDERITE**

Manuale di ricondizionamento

0900-5032-ITIT Rev-04

# PRODOTTI GLIDESCOPE E GLIDERITE

## Manuale di ricondizionamento

Valido da: 16 marzo 2021

Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti autorizza l'utilizzo di questo dispositivo al solo personale medico o dietro sua indicazione.

# INFORMAZIONI DI CONTATTO

Per ottenere ulteriori informazioni sul sistema GlideScope,  
contattare l'Assistenza clienti Verathon o visitare il sito web [verathon.com/global-support](http://verathon.com/global-support).

**Verathon Inc.**  
20001 North Creek Parkway  
Bothell, WA 98011 U.S.A.  
Tel.: +1 800 331 2313 (solo USA e Canada)  
Tel: +1 425 867 1348  
Fax: +1 425 883 2896  
[verathon.com](http://verathon.com)

 **Verathon Medical (Europa) B.V.**  
Willem Fenengastraat 13  
1096 BL Amsterdam  
Paesi Bassi  
Tel.: +31 (0) 20 210 30 91  
Fax: +31 (0) 20 210 30 92

 **Verathon Medical (Canada) ULC**  
2227 Douglas Road  
Burnaby, BC V5C 5A9  
Canada  
Tel: +1 604 439 3009  
Fax: +1 604 439 3039

**Verathon Medical (Australia) Pty Limited**  
Unit 9, 39 Herbert Street  
St Leonards NSW 2065  
Australia  
Chiamate dell'Australia: 1800 613 603 Tel./ 1800 657 970 Fax  
Chiamate internazionali: +61 2 9431 2000 Tel / +61 2 9475 1201 Fax

Copyright © 2021 di Verathon Inc. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta o trasmessa con qualsiasi mezzo senza l'esplicito consenso scritto di Verathon Inc.

GlideScope, il simbolo GlideScope, BFlex, GlideRite, Verathon e il simbolo della torcia di Verathon sono marchi o marchi registrati di Verathon Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Non tutti i prodotti Verathon Inc. mostrati o descritti nel presente manuale sono disponibili per la vendita commerciale in tutti i paesi.

Le informazioni contenute nel presente manuale possono essere modificate in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Per informazioni più aggiornate, consultare la documentazione disponibile sul sito [verathon.com/product-documentation](http://verathon.com/product-documentation).

# AVVIO RAPIDO

---

## VIDEOCAMERE AVL



Panoramica .....	7
Preparazione per la pulizia .....	8
Pulizia (con un prodotto liquido) .....	10
Pulizia (con salviettine) .....	13
Disinfezione (con salviettine) .....	16

## VIDEOCAMERA 2.0



Panoramica .....	18
Preparazione per la pulizia .....	20
Pulizia (con un prodotto liquido) .....	22
Pulizia (con salviettine) .....	25
Disinfezione (con salviettine) .....	28

## VIDEOCAMERA QC



Panoramica .....	30
Preparazione per la pulizia .....	32
Pulizia (con un prodotto liquido) .....	34
Pulizia (con salviettine) .....	37
Disinfezione (con salviettine) .....	40

# VIDEO LARINGOSCOPI RIUTILIZZABILI TITANIUM



Panoramica .....	42
Preparazione per la pulizia .....	44
Pulizia (con un prodotto liquido) .....	46
Pulizia (con salviettine) .....	53
Disinfezione (con un prodotto liquido) .....	57
Disinfezione (con salviettine) .....	64
Sterilizzazione .....	66

# MONITOR GLIDESCOPE CORE, POSTAZIONE DI LAVORO,

## E ALIMENTATORE



Panoramica .....	69
Pulizia del monitor .....	71
Pulizia della postazione di lavoro e dell'adattatore .....	72

# MONITOR E BASE DI RICARICA GLIDESCOPE GO



Panoramica .....	73
Preparazione per la pulizia .....	74
Pulizia (con un prodotto liquido) .....	75
Pulizia (con salviettine) .....	79
Disinfezione (con un prodotto liquido) .....	83
Disinfezione (con salviettine) .....	85
Pulizia della base di ricarica .....	87

# MONITOR VIDEO GLIDESCOPE, CARRELLO PREMIUM, SUPPORTO MOBILE E ADATTATORE



Panoramica.....	88
Pulizia del monitor .....	90
Pulizia dell'adattatore.....	91
Pulizia del carrello GlideScope Premium o del supporto mobile .....	92

# MANDRINI RIUTILIZZABILI GLIDERITE



Panoramica.....	93
Pulizia (con un prodotto liquido) .....	95
Pulizia (con salviettine) .....	100
Disinfezione .....	102
Sterilizzazione .....	108

## CAVI QUICKCONNECT



Panoramica.....	111
Preparazione per la pulizia .....	112
Pulizia (con un prodotto liquido) .....	114
Pulizia (con salviettine) .....	118
Disinfezione (con un prodotto liquido) .....	122
Disinfezione (con salviettine) .....	126

## CAVI VIDEO E SMART CABLES



Panoramica.....	128
Preparazione per la pulizia .....	130
Pulizia (con un prodotto liquido) .....	132
Pulizia (con salviettine) .....	138
Disinfezione (con un prodotto liquido) .....	144
Disinfezione (con salviettine) .....	151
Sterilizzazione .....	154

# SOMMARIO

---

<b>INFORMAZIONI IMPORTANTI .....</b>	<b>1</b>
Informazioni introduttive .....	1
Avviso a tutti gli utenti di questo manuale .....	1
Avvertenze e precauzioni .....	2
<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE .....</b>	<b>6</b>
Videocamere AVL .....	7
Procedura 1. <i>Preparazione delle videocamere AVL per la pulizia</i> .....	8
Procedura 2. <i>Pulizia della videocamera AVL</i> .....	10
Procedura 3. <i>Disinfezione della videocamera AVL (facoltativa)</i> .....	15
Videocamera 2.0 .....	18
Procedura 1. <i>Preparazione della videocamera 2.0 per la pulizia</i> .....	20
Procedura 2. <i>Pulizia della videocamera 2.0</i> .....	22
Procedura 3. <i>Disinfezione della videocamera 2.0 (facoltativa)</i> .....	27
Videocamera QC .....	30
Procedura 1. <i>Preparazione della videocamera per la pulizia</i> .....	32
Procedura 2. <i>Pulizia della videocamera QC</i> .....	34
Procedura 3. <i>Disinfezione della videocamera QC (facoltativa)</i> .....	39
Video laringoscopi riutilizzabili Titanium.....	42
Procedura 1. <i>Preparazione di un video laringoscopio riutilizzabile per la pulizia</i> .....	44
Procedura 2. <i>Pulizia del video laringoscopio riutilizzabile Titanium</i> .....	46
Procedura 3. <i>Disinfezione del video laringoscopio riutilizzabile Titanium</i> .....	56
Procedura 4. <i>Sterilizzazione del video laringoscopio riutilizzabile Titanium (facoltativa)</i> .....	66
Monitor GlideScope Core, postazione di lavoro, e alimentatore .....	69
Procedura 1. <i>Pulizia del monitor GlideScope Core</i> .....	71
Procedura 2. <i>Pulizia della postazione di lavoro e dell'adattatore GlideScope Core</i> .....	72

Monitor e base di ricarica GlideScope Go .....	73
Procedura 1. <i>Preparazione del monitor GlideScope Go per la pulizia</i> .....	74
Procedura 2. <i>Pulizia del monitor GlideScope Go</i> .....	74
Procedura 3. <i>Disinfezione del monitor GlideScope Go (facoltativa)</i> .....	82
Procedura 4. <i>Pulizia della base di ricarica GlideScope Go</i> .....	87
Monitor video GlideScope, carrello Premium, supporto mobile e adattatore .....	88
Procedura 1. <i>Pulizia del monitor video GlideScope</i> .....	90
Procedura 2. <i>Pulizia dell'adattatore del monitor video GlideScope</i> .....	91
Procedura 3. <i>Pulizia del carrello Premium o del supporto mobile per il monitor video GlideScope</i> .....	92
Mandrini riutilizzabili GlideRite.....	93
Procedura 1. <i>Pulizia del mandrino riutilizzabile GlideRite</i> .....	95
Procedura 2. <i>Disinfezione del mandrino riutilizzabile GlideRite</i> .....	102
Procedura 3. <i>Sterilizzazione del mandrino riutilizzabile GlideRite (facoltativa)</i> .....	108
Cavi QuickConnect .....	111
Procedura 1. <i>Preparazione di un cavo QuickConnect per la pulizia</i> .....	112
Procedura 2. <i>Pulizia di un cavo QuickConnect</i> .....	114
Procedura 3. <i>Disinfezione di un cavo QuickConnect Cable (facoltativa)</i> .....	122
Cavi video e Smart Cables.....	128
Procedura 1. <i>Preparazione di un cavo video o di uno Smart Cable per la pulizia</i> .....	130
Procedura 2. <i>Pulizia di un cavo video o Smart Cable</i> .....	132
Procedura 3. <i>Disinfezione di un cavo video o Smart Cable (facoltativa)</i> .....	143
Procedura 4. <i>Sterilizzazione di un cavo video o Smart Cable (facoltativa)</i> .....	154
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>158</b>



# INFORMAZIONI IMPORTANTI

---

## INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

Le procedure di pulizia e disinfezione costituiscono un aspetto estremamente importante per l'utilizzo e la manutenzione dei componenti riutilizzabili. Prima di ciascun utilizzo, verificare che tutti i componenti siano stati puliti, disinfezati o sterilizzati in base alle istruzioni riportate in questo manuale. È inoltre necessario esaminare periodicamente il sistema GlideScope per assicurarne il corretto funzionamento. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di funzionamento e manutenzione opportuno.

Per le definizioni e ulteriori informazioni sulle linee guida di pulizia, disinfezione e sterilizzazione, consultare la pagina Disinfezione e sterilizzazione dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (<http://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/index.html>).

La disponibilità e la compliance normativa dei prodotti di pulizia, disinfezione e sterilizzazione come indicato nel presente manuale variano a seconda dell'area geografica. Verificare di aver selezionato i prodotti in conformità con le leggi e normative locali.

*Nota: Per la pulizia, la disinfezione o la sterilizzazione dei prodotti Verathon, utilizzare soltanto i processi descritti nel presente manuale. Altri metodi potrebbero non essere efficaci su tali prodotti oppure non compatibili con i materiali di cui sono costituiti.*

## AVVISO A TUTTI GLI UTENTI DI QUESTO MANUALE

Verathon raccomanda a tutti gli utilizzatori dei prodotti descritti nel presente manuale di:

- Leggere il Manuale di funzionamento e manutenzione associato a ciascuna apparecchiatura prima di utilizzarla.
- Ottenere le istruzioni da personale qualificato.

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le avvertenze indicano che l'utilizzo o l'utilizzo improprio del dispositivo può provocare ferite, decesso o altre gravi reazioni avverse. Le *precauzioni* indicano che l'utilizzo o l'utilizzo improprio del dispositivo può causare problemi quali malfunzionamento, guasti o danni al prodotto.

### AVVERTENZE: PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE



#### AVVERTENZA

Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il dispositivo funzioni correttamente e non siano presenti danni. Non utilizzare questo prodotto, se il dispositivo risulta danneggiato. Rivolgersi al personale qualificato per la riparazione.

Assicurarsi sempre che siano immediatamente disponibili altri metodi e apparecchi per la gestione delle vie aeree.

Riferire qualsiasi possibile difetto all'Assistenza clienti Verathon. Per informazioni di contatto, visitare la pagina [verathon.com/global-support](http://verathon.com/global-support).



#### AVVERTENZA

Non riutilizzare, ricondizionare o risterilizzare i componenti monouso. Il riutilizzo, ricondizionamento o la risterilizzazione possono contaminare il componente o il sistema GlideScope.



#### AVVERTENZA

Accertarsi che ogni componente sia completamente pulito, prima di disinfeccarlo o sterilizzarlo. Se non lo è, la procedura di disinfezione o sterilizzazione potrebbe non rimuovere tutti gli agenti contaminanti, con conseguente aumento del rischio di infezione.

## AVVERTENZE: SICUREZZA DEL PRODOTTO



### AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di elettrocuzione, prima di pulire il monitor o la postazione di lavoro, spegnere il monitor e scollegare l'alimentazione. Scollegare la spina di alimentazione dalla sorgente di corrente CA.



### AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche. Non immergere in acqua l'adattatore. Piuttosto, utilizzare un panno inumidito di alcool isopropilico per pulire le parti esterne dell'adattatore.

## ATTENZIONE



### ATTENZIONE

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfeccati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.



### ATTENZIONE

Evitare che i componenti del sistema GlideScope vengano a contatto con liquidi diversi da quelli raccomandati nel presente manuale. L'esposizione a liquidi può danneggiare le parti elettroniche o interne di alcuni componenti.



### ATTENZIONE

Per le raccomandazioni sulla manipolazione e sullo smaltimento di un agente di ricondizionamento, consultare le istruzioni del produttore dell'agente di ricondizionamento.



### ATTENZIONE

I componenti riutilizzabili dei sistemi GlideScope non sono spediti in condizioni sterili. Prima del primo utilizzo, è dunque necessario pulirli e disinfecciarli o sterilizzarli, se opportuno. In caso contrario, aumenta il rischio di infezione.



### ATTENZIONE

Non utilizzare spazzole, tamponi o strumenti abrasivi per la pulizia di videocamere o schermi. Questi oggetti possono graffiare le parti di plastica trasparente e danneggiare definitivamente il dispositivo.



### ATTENZIONE

Non utilizzare un dispositivo ultrasonico o apparecchi di lavaggio automatici per pulire un prodotto Verathon, a meno che non si tratti di sistemi di pulizia approvati da Verathon e compatibili con tali sistemi. L'utilizzo di apparecchi ultrasonici o di lavaggio automatici per la pulizia di qualsiasi altro prodotto Verathon, oppure l'utilizzo di sistemi di pulizia automatici non elencati come compatibili, potrebbe danneggiare il prodotto.



### ATTENZIONE

Non esporre il componente del sistema GlideScope a temperature superiori a 60 °C (140 °F), né utilizzare autoclavi o altri sistemi di sterilizzazione termici diversi da quelli descritti nel presente manuale. L'esposizione a calore eccessivo danneggia irreparabilmente il dispositivo e comporta l'annullamento della garanzia.

# INTRODUZIONE

---

Il presente manuale fornisce i requisiti e le procedure di ricondizionamento (pulizia, disinfezione e sterilizzazione) per i prodotti GlideScope e GlideRite. Il manuale viene costantemente aggiornato per rispecchiare le informazioni nuove e modificate in merito al ricondizionamento. Per le istruzioni di funzionamento e manutenzione per i sistemi e dispositivi GlideScope e GlideRite, consultare il rispettivo Manuale di funzionamento e manutenzione.

Le versioni attuali dei manuali di tutti i prodotti Verathon sono disponibili online alla pagina [verathon.com/product-documentation](http://verathon.com/product-documentation).

# PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE

---

Le informazioni sul ricondizionamento fornite nel presente manuale sono organizzate per linea di prodotti.

*Nota: Il presente manuale non include i componenti monouso. I cavi utilizzati per il collegamento di tali componenti ai monitor video elencati sono tutti descritti nelle sezioni [Cavi QuickConnect](#) a pagina 111 e [Cavi video e Smart Cables](#) a pagina 128.*

La sezione di ogni prodotto fornisce le seguenti informazioni per i componenti di tale prodotto:

- requisiti di ricondizionamento
- compatibilità dei materiali
- istruzioni specifiche per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione (per prodotti di efficacia verificata)



# VIDEOCAMERE AVL



Leggere la sezione **Avvertenze e precauzioni** prima di eseguire le operazioni descritte in questa sezione.

## IMPORTANTE

Non lasciare che eventuali agenti contaminanti si depositino a lungo sul dispositivo. Una volta incrostatati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere.

Quando si utilizzano i disinfettanti elencati nel presente manuale, leggere e attenersi alle istruzioni per l'uso del prodotto in tutte le applicazioni.

*Nota: si presuppone che tutti i componenti elencati nella tabella seguente siano utilizzati come previsto.*

Tabella 1. Requisiti di ricondizionamento per le videocamere AVL

DISPOSITIVO	LIVELLI DI RICONDIZIONAMENTO RICHIESTI			
	Pulizia	Basso	Alto	Sterilizzazione
Videocamera	✓			

*I livelli di ricondizionamento mostrati in questa tabella si riferiscono alle classificazioni CDC/Spaulding.*

## IMPORTANTE

Le informazioni sui prodotti di ricondizionamento materialmente compatibili ed efficaci sono disponibili nella tabella della pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts). Esaminare queste informazioni, prima di eseguire le procedure descritte in questo capitolo.

## COMPONENTI TRATTATI IN QUESTA SEZIONE

Questa sezione del manuale contiene le istruzioni di ricondizionamento per i componenti seguenti:



Videocamera AVL 1-2



Videocamera AVL 3-4




## PROCEDURA 1. PREPARAZIONE DELLE VIDEOCAMERE AVL PER LA PULIZIA

### IMPORTANTE

La lama Stat è un dispositivo monouso e sterile. Dopo l'uso, è necessario rimuoverla dalla videocamera e smaltrirla come previsto dai protocolli locali, poiché rappresenta un rischio biologico.

**1**



Accertarsi che il monitor sia stato spento.


**2**



Scollegare il cavo video.

Ruotare l'anello connettore nella direzione indicata dalla freccia di rilascio, quindi tirare.

**3**



Applicare il cappuccio protettivo sul connettore del cavo video.

La freccia sulla presa del connettore deve essere allineata al punto sul cappuccio.

**4**





Rimuovere la lama Stat.

Tenendo la lama Stat in una mano, premere sul suo collare con il pollice e l'indice.

Con l'altra mano afferrare l'impugnatura della videocamera e tirare saldamente.

Smaltire la lama Stat nel rispetto dei protocolli locali.



5		<p><b>Applicare un pre-detergente (facoltativo).</b> Una volta incrostati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere. Per informazioni sui pre-detergenti compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina <a href="http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts">verathon.com/glidescope_reprocessingproducts</a>.</p>
6		<p><b>Pulire il componente.</b> Continuare con <b>Pulizia della videocamera AVL</b> a pagina 10.</p>




## PROCEDURA 2. PULIZIA DELLA VIDEOCAMERA AVL

Se utilizzata correttamente, la videocamera è un dispositivo riutilizzabile e non sterile, che è però protetto dal contatto con le membrane mucose e la cute non integra dalla lama Stat monouso e sterile.


### PULIZIA DELLA VIDEOCAMERA AVL (CON UN PRODOTTO LIQUIDO)

!		<p>Prima di pulirlo, il componente deve essere preparato. Per le istruzioni, consultare <a href="#">Preparazione delle videocamere AVL per la pulizia a pagina 8</a>.</p>
1		<p>Preparare la soluzione detergente. Per la concentrazione, la temperatura e altre istruzioni per la preparazione, consultare <a href="#">Tabella 2 a pagina 12</a>.</p>
2		<p>Lavare il componente nella soluzione detergente. Per il tempo di esposizione, la temperatura e altre istruzioni per il lavaggio, consultare <a href="#">Tabella 2 a pagina 12</a>. (Queste informazioni variano a seconda della soluzione detergente utilizzata.)</p>
3		<p>Sciacquare il componente per rimuovere la soluzione detergente. Per il tempo di risciacquo, la temperatura e altre istruzioni per il risciacquo, consultare <a href="#">Tabella 2 a pagina 12</a>. (Queste informazioni variano a seconda della soluzione detergente utilizzata.)</p>

**4**

Esaminare il componente per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa.


Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 2.

**5**

**Asciugare il componente.**

Utilizzare aria pulita di tipo ospedaliero per soffiare via l'umidità residua dai connettori, quindi asciugare il componente con uno dei metodi seguenti:

- aria pulita di tipo ospedaliero
- un panno pulito che non lascia pelucchi

**6**

**Disinfettare il componente (facoltativo).**

Per la disinfezione, procedere con [Disinfezione della videocamera AVL \(facoltativa\) a pagina 15](#).

Altrimenti, conservare il dispositivo in un ambiente pulito.



**ATTENZIONE**

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfezionati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (PRODOTTI LIQUIDI)

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 2. Soluzioni detergenti per videocamere AVL

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
STERIS Prolystica 2x Prodotto enzimatico concentrato per la pulizia e la pre-immersione	Pulizia	2.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente a una temperatura di 35 °C±5°C e in una concentrazione di 1–4 ml/l (½–½ once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per almeno 3 minuti. Prima di estrarre il componente dalla soluzione, pulire tutte le superfici con una spazzola a setole morbide prestando particolare attenzione alle zone più difficili da raggiungere. Pulire la finestra della videocamera con un cotton fioc per evitare di danneggiarla.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente tiepida per 3 minuti. Se il componente rimane immerso per più di 3 minuti, aumentare il tempo di risciacquo in proporzione.</p> <p style="text-align: right;"><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



## PULIZIA DELLA VIDEOCAMERA AVL (CON SALVIETTE)

!		<p>Prima di pulirlo, il componente deve essere preparato. Per le istruzioni, consultare <a href="#">Preparazione delle videocamere AVL per la pulizia a pagina 8</a>.</p>
1		<p><b>Pulire il componente strofinandolo con le salviette.</b> Strofinare nuovamente il componente con le salviette ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare tutte le salviette necessarie. Per istruzioni specifiche, consultare <a href="#">Tabella 3 a pagina 14</a>. (Queste informazioni variano a seconda delle salviette utilizzate.)</p>
2		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa. Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 1.</p>
3		<p><b>Asciugare il componente.</b> Lasciarlo asciugare bene all'aria.</p>
4		<p><b>Disinfettare il componente (facoltativo).</b> Per la disinfezione, procedere con <a href="#">Disinfezione della videocamera AVL (facoltativa) a pagina 15</a>. Altrimenti, conservare il dispositivo in un ambiente pulito.</p>



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (SALVIETTE)

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 3. Salviette di pulizia per videocamere AVL

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviettine germicide AF3 Sani- Cloth	Pulizia	2.000	Pulire il componente seguendo le istruzioni del produttore del prodotto chimico. <b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



## PROCEDURA 3. DISINFEZIONE DELLA VIDEOCAMERA AVL (FACOLTATIVA)



### AVVERTENZA

Accertarsi che ogni componente sia completamente pulito, prima di disinfeztarlo o sterilizzarlo. Se non lo è, la procedura di disinfezione o sterilizzazione potrebbe non rimuovere tutti gli agenti contaminanti, con conseguente aumento del rischio di infezione.




Leggere la sezione [Avvertenze e precauzioni](#) prima di eseguire la seguente operazione.

### PRIMA DI INIZIARE

Prima di iniziare la procedura di disinfezione del componente, assicurarsi di svolgere le seguenti azioni:


- Pulire il componente secondo le istruzioni e gli standard descritti nella sezione precedente, [Pulizia della videocamera AVL](#).
- Accertarsi che il cappuccio protettivo sul connettore sia fissato saldamente. La freccia sul connettore deve essere allineata con il punto sul cappuccio protettivo.

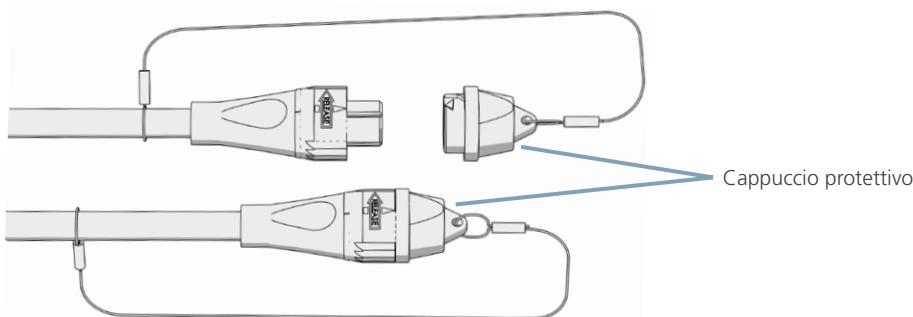




## DISINFEZIONE DELLA VIDEOCAMERA AVL (CON SALVIETTE)

1




Pulire il componente strofinandolo con le salviette.  
Strofinare nuovamente il componente con le salviette ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare tutte le salviette necessarie.  
Per istruzioni specifiche, consultare **Tabella 4** a pagina 17.  
(Queste informazioni variano a seconda delle salviette utilizzate.)

2




Asciugare il componente.  
Lasciarlo asciugare bene all'aria.

3



Esaminare il componente per accertarsi che non sia danneggiato.  
Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura.  
Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.

4



Conservare il componente in un ambiente pulito.



### AVVERTENZA

Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il dispositivo funzioni correttamente e non siano presenti danni. Non utilizzare questo prodotto, se il dispositivo risulta danneggiato. Rivolgersi al personale qualificato per la riparazione.

Assicurarsi sempre che siano immediatamente disponibili altri metodi e apparecchi per la gestione delle vie aeree.

Riferire qualsiasi possibile difetto all'Assistenza clienti Verathon. Per informazioni di contatto, visitare la pagina [verathon.com/global-support](http://verathon.com/global-support).



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 4. Salviette disinfettanti per videocamere AVL

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviettine germicide AF3 Sani-Cloth	Basso	2.000	<b>Esposizione:</b> strofinare tutte le superfici del componente con salviette pulite e lasciare agire per 3 minuti. <b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria. <b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



## VIDOCAMERA 2.0



Leggere la sezione **Avvertenze e precauzioni** prima di eseguire le operazioni descritte in questa sezione.

### IMPORTANTE

Non lasciare che eventuali agenti contaminanti si depositino a lungo sul dispositivo. Una volta incrostatati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere.

Quando si utilizzano i disinfettanti elencati nel presente manuale, leggere e attenersi alle istruzioni per l'uso del prodotto in tutte le applicazioni.

*Nota: si presuppone che tutti i componenti elencati nella tabella seguente siano utilizzati come previsto.*

*Tabella 5. Requisiti di ricondizionamento per la videocamera 2.0*

DISPOSITIVO	LIVELLI DI RICONDIZIONAMENTO RICHIESTI			
	Pulizia	Basso	Alto	Sterilizzazione
Videocamera	✓			

*I livelli di ricondizionamento mostrati in questa tabella si riferiscono alle classificazioni CDC/Spaulding.*

### IMPORTANTE

Le informazioni sui prodotti di ricondizionamento materialmente compatibili ed efficaci sono disponibili nella tabella della pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts). Esaminare queste informazioni, prima di eseguire le procedure descritte in questo capitolo.

## COMPONENTI TRATTATI IN QUESTA SEZIONE

Questa sezione del manuale contiene le istruzioni di ricondizionamento per il componente seguente:



Videocamera 2.0 grande  
(3-4)




## NOTE

## PROCEDURA 1. PREPARAZIONE DELLA VIDEOCAMERA 2.0 PER LA PULIZIA

### IMPORTANTE

La lama Stat è un dispositivo monouso e sterile. Dopo l'uso, è necessario rimuoverla dalla videocamera e smaltrirla come previsto dai protocolli locali, poiché rappresenta un rischio biologico.

1



Accertarsi che il monitor sia stato spento.

2



Scollegare il cavo video, se presente.

- Monitor video GlideScope: ruotare l'anello connettore nella direzione indicata dalla freccia, quindi tirare.
- Monitor Core: tenere il connettore in una mano e sostenere il monitor con l'altra, quindi tirare.

3



Scollegare la videocamera.

Afferrare la camera e la lama Stat in una mano e il connettore HDMI collegato nell'altra. Tirare con decisione per separare i due dispositivi.

4





Rimuovere la lama Stat.

Tenendo la lama Stat in una mano, premere sul suo collare con il pollice e l'indice.

Con l'altra mano afferrare l'impugnatura della videocamera e tirare saldamente.

Smaltire la lama Stat nel rispetto dei protocolli locali.



5		<p><b>Applicare un pre-detergente (facoltativo).</b> Una volta incrostati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere. Per informazioni sui pre-detergenti compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina <a href="http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts">verathon.com/glidescope_reprocessingproducts</a>.</p>
6		<p><b>Pulire il componente.</b> Continuare con <b>Pulizia della videocamera 2.0</b> a pagina 22.</p>

## PROCEDURA 2. PULIZIA DELLA VIDEOCAMERA 2.0



### AVVERTENZA

Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il dispositivo funzioni correttamente e non siano presenti danni. Non utilizzare questo prodotto, se il dispositivo risulta danneggiato. Rivolgersi al personale qualificato per la riparazione.

Assicurarsi sempre che siano immediatamente disponibili altri metodi e apparecchi per la gestione delle vie aeree.

Riferire qualsiasi possibile difetto all'Assistenza clienti Verathon. Per informazioni di contatto, visitare la pagina [verathon.com/global-support](http://verathon.com/global-support).


Se utilizzata correttamente, la videocamera è un dispositivo riutilizzabile e non sterile, che è però protetto dal contatto con le membrane mucose e la cute non integra dalla lama Stat monouso e sterile.

### PULIZIA DELLA VIDEOCAMERA 2.0 (CON UN PRODOTTO LIQUIDO)

!		<p>Prima di pulirlo, il componente deve essere preparato. Per le istruzioni, consultare <a href="#">Preparazione della videocamera 2.0 per la pulizia a pagina 20</a>.</p>
1		<p>Preparare la soluzione detergente. Per la concentrazione, la temperatura e altre istruzioni per la preparazione, consultare <a href="#">Tabella 6 a pagina 24</a>.</p>
2		<p>Lavare il componente nella soluzione detergente. Per il tempo di esposizione, la temperatura e altre istruzioni per il lavaggio, consultare <a href="#">Tabella 6 a pagina 24</a>. (Queste informazioni variano a seconda della soluzione detergente utilizzata.)</p>




3




**Sciacquare il componente** per rimuovere la soluzione detergente.  
Per il tempo di risciacquo, la temperatura e altre istruzioni per il risciacquo, consultare **Tabella 6 a pagina 24.**  
(Queste informazioni variano a seconda della soluzione detergente utilizzata.)

4



**Esaminare il componente** per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa.  
Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 2.


5



**Asciugare il componente.**  
Utilizzare aria pulita di tipo ospedaliero per soffiare via l'umidità residua dai connettori, quindi asciugare il componente con uno dei metodi seguenti:

- aria pulita di tipo ospedaliero
- un panno pulito che non lascia pelucchi

6



**Disinfettare il componente (facoltativo).**  
Per la disinfezione, procedere con **Disinfezione della videocamera 2.0 (facoltativa)** a pagina 27.  
Altrimenti, conservare il dispositivo in un ambiente pulito.



### ATTENZIONE

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfettati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.

## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (PRODOTTI LIQUIDI)

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 6. Soluzioni per la pulizia della videocamera 2.0

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
STERIS Prolystica 2x Prodotto enzimatico concentrato per la pulizia e la pre-immersione	Pulizia	2.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente a una temperatura di 35 °C±5°C e in una concentrazione di 1–4 ml/l (1½–½ once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per almeno 3 minuti. Prima di estrarre il componente dalla soluzione, pulire tutte le superfici con una spazzola a setole morbide prestando particolare attenzione alle zone più difficili da raggiungere. Pulire la finestra della videocamera con un cotton fioc per evitare di danneggiarla.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente tiepida per 3 minuti. Se il componente rimane immerso per più di 3 minuti, aumentare il tempo di risciacquo in proporzione.</p> <p>◀ <b>Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



## PULIZIA DELLA VIDEOCAMERA 2.0 (CON SALVIETTE)

!		<p>Prima di pulirlo, il componente deve essere preparato. Per le istruzioni, consultare <a href="#">Preparazione della videocamera 2.0 per la pulizia</a> a pagina 20.</p>
1		<p><b>Pulire il componente strofinandolo con le salviette.</b> Strofinare nuovamente il componente con le salviette ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare tutte le salviette necessarie. Per istruzioni specifiche, consultare <a href="#">Tabella 7</a> a pagina 26. (Queste informazioni variano a seconda delle salviette utilizzate.)</p>
2		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa. Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 1.</p>
3		<p><b>Asciugare il componente.</b> Lasciarlo asciugare bene all'aria.</p>
4		<p><b>Disinfettare il componente (facoltativo).</b> Per la disinfezione, procedere con <a href="#">Disinfezione della videocamera 2.0 (facoltativa)</a> a pagina 27. Altrimenti, conservare il dispositivo in un ambiente pulito.</p>



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (SALVIETTE)

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 7. Salviette detergenti per la videocamera 2.0

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviettine germicide AF3 Sani- Cloth	Pulizia	2.000	Pulire il componente seguendo le istruzioni del produttore del prodotto chimico. <b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



## PROCEDURA 3. DISINFEZIONE DELLA VIDEOCAMERA 2.0 (FACOLTATIVA)



### AVVERTENZA

Accertarsi che ogni componente sia completamente pulito, prima di disinfeztarlo o sterilizzarlo. Se non lo è, la procedura di disinfezione o sterilizzazione potrebbe non rimuovere tutti gli agenti contaminanti, con conseguente aumento del rischio di infezione.






Leggere la sezione [Avvertenze e precauzioni](#) prima di eseguire la seguente operazione.

### PRIMA DI INIZIARE

Prima di iniziare la procedura di disinfezione del componente, assicurarsi di svolgere le seguenti azioni:

- Pulire il componente secondo le istruzioni e gli standard descritti nella sezione precedente, [Pulizia della videocamera 2.0](#).
- Non posizionare i cappucci protettivi sui connettori della videocamera 2.0. Questo componente è progettato per essere immerso completamente, senza l'utilizzo di cappucci protettivi, che Verathon peraltro non fornisce.

## DISINFEZIONE DELLA VIDEOCAMERA 2.0 (CON SALVIETTE)

1		<p>Pulire il componente strofinandolo con le salviette. Strofinare nuovamente il componente con le salviette ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare tutte le salviette necessarie. Per istruzioni specifiche, consultare <a href="#">Tabella 8 a pagina 29</a>. (Queste informazioni variano a seconda delle salviette utilizzate.)</p>
2		<p>Asciugare il componente. Lasciarlo asciugare bene all'aria.</p>
3		<p>Esaminare il componente per accertarsi che non sia danneggiato. Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura. Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.</p>
4		<p>Conservare il componente in un ambiente pulito.</p>



### AVVERTENZA

Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il dispositivo funzioni correttamente e non siano presenti danni. Non utilizzare questo prodotto, se il dispositivo risulta danneggiato. Rivolgersi al personale qualificato per la riparazione.

Assicurarsi sempre che siano immediatamente disponibili altri metodi e apparecchi per la gestione delle vie aeree.

Riferire qualsiasi possibile difetto all'Assistenza clienti Verathon. Per informazioni di contatto, visitare la pagina [verathon.com/global-support](http://verathon.com/global-support).



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 8. Salviette disinfettanti per la videocamera 2.0

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviettine germicide AF3 Sani-Cloth	Basso	2.000	<b>Esposizione:</b> strofinare tutte le superfici del componente con salviette pulite e lasciare agire per 3 minuti. <b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria. <b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>

# VIDOCAMERA QC



Leggere la sezione **Avvertenze e precauzioni** prima di eseguire le operazioni descritte in questa sezione.

## IMPORTANTE

Non lasciare che eventuali agenti contaminanti si depositino a lungo sul dispositivo. Una volta incrostatati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere.

Quando si utilizzano i disinfettanti elencati nel presente manuale, leggere e attenersi alle istruzioni per l'uso del prodotto in tutte le applicazioni.

*Nota: si presuppone che tutti i componenti elencati nella tabella seguente siano utilizzati come previsto.*

Tabella 9. Requisiti di ricondizionamento per la videocamera QC

DISPOSITIVO	LIVELLI DI RICONDIZIONAMENTO RICHIESTI			
	Pulizia	Basso	Alto	Sterilizzazione
Videocamera QC grande	✓			

*I livelli di ricondizionamento mostrati in questa tabella si riferiscono alle classificazioni CDC/Spaulding.*

## IMPORTANTE

Le informazioni sui prodotti di ricondizionamento materialmente compatibili ed efficaci sono disponibili nella tabella della pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts). Esaminare queste informazioni, prima di eseguire le procedure descritte in questo capitolo.

## COMPONENTI TRATTATI IN QUESTA SEZIONE

Questa sezione del manuale contiene le istruzioni di ricondizionamento per il componente seguente:



Videocamera QC grande




## NOTE

## PROCEDURA 1. PREPARAZIONE DELLA VIDEOCAMERA PER LA PULIZIA

### IMPORTANTE


La lama Stat è un dispositivo monouso e sterile. Dopo l'uso, è necessario rimuoverla dalla videocamera e smaltrirla come previsto dai protocolli locali, poiché rappresenta un rischio biologico.

**1**



Accertarsi che il monitor sia stato spento.

**2**



Scollegare il cavo video, se presente.

Tenere il connettore in una mano e sostenere il monitor con l'altra, quindi tirare.

**3**



Scollegare la videocamera.

Afferrare la camera e la lama Stat in una mano e il connettore del cavo QuickConnect collegato nell'altra. Tirare con decisione per separare i due dispositivi.

**4**





Rimuovere la lama Stat.

Tenendo la lama Stat in una mano, premere sul suo collare con il pollice e l'indice.

Con l'altra mano afferrare l'impugnatura della videocamera e tirare saldamente.

Smaltire la lama Stat nel rispetto dei protocolli locali.



5		<p><b>Applicare un pre-detergente (facoltativo).</b> Una volta incrostati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere. Per informazioni sui pre-detergenti compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina <a href="http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts">verathon.com/glidescope_reprocessingproducts</a>.</p>
6		<p><b>Pulire il componente.</b> Continuare con <b>Pulizia della videocamera QC</b> a pagina 34.</p>

## PROCEDURA 2. PULIZIA DELLA VIDEOCAMERA QC



### AVVERTENZA

Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il dispositivo funzioni correttamente e non siano presenti danni. Non utilizzare questo prodotto, se il dispositivo risulta danneggiato. Rivolgersi al personale qualificato per la riparazione.

Assicurarsi sempre che siano immediatamente disponibili altri metodi e apparecchi per la gestione delle vie aeree.

Riferire qualsiasi possibile difetto all'Assistenza clienti Verathon. Per informazioni di contatto, visitare la pagina [verathon.com/global-support](http://verathon.com/global-support).


Se utilizzata correttamente, la videocamera è un dispositivo riutilizzabile e non sterile, che è però protetto dal contatto con le membrane mucose e la cute non integra dalla lama Stat monouso e sterile.

### PULIZIA DELLA VIDEOCAMERA QC (CON UN PRODOTTO LIQUIDO)

!		<p>Prima di pulirlo, il componente deve essere preparato. Per le istruzioni, consultare <a href="#">Preparazione della videocamera per la pulizia a pagina 32</a>.</p>
1		<p>Preparare la soluzione detergente. Per la concentrazione, la temperatura e altre istruzioni per la preparazione, consultare <a href="#">Tabella 10 a pagina 36</a>.</p>
2		<p>Lavare il componente nella soluzione detergente. Per il tempo di esposizione, la temperatura e altre istruzioni per il lavaggio, consultare <a href="#">Tabella 10 a pagina 36</a>. (Queste informazioni variano a seconda della soluzione detergente utilizzata.)</p>




3




**Sciacquare il componente** per rimuovere la soluzione detergente.  
Per il tempo di risciacquo, la temperatura e altre istruzioni per il risciacquo, consultare [Tabella 10 a pagina 36](#).  
(Queste informazioni variano a seconda della soluzione detergente utilizzata.)

4



**Esaminare il componente** per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa.  
Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 2.


5



**Asciugare il componente.**  
Utilizzare aria pulita di tipo ospedaliero per soffiare via l'umidità residua dai connettori, quindi asciugare il componente con uno dei metodi seguenti:

- aria pulita di tipo ospedaliero
- un panno pulito che non lascia pelucchi

6



**Disinfettare il componente (facoltativo).**  
Per la disinfezione, procedere con [Disinfezione della videocamera QC \(facoltativa\)](#) a pagina 39.  
Altrimenti, conservare il dispositivo in un ambiente pulito.



### ATTENZIONE

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfettati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (PRODOTTI LIQUIDI)

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 10. Soluzioni per la pulizia della videocamera QC

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
STERIS Prolystica 2x Prodotto enzimatico concentrato per la pulizia e la pre-immersione	Pulizia	2.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente a una temperatura di 35 °C±5°C e in una concentrazione di 1–4 ml/l (½–½ once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per almeno 3 minuti. Prima di estrarre il componente dalla soluzione, pulire tutte le superfici con una spazzola a setole morbide prestando particolare attenzione alle zone più difficili da raggiungere. Pulire la finestra della videocamera con un cotton fioc per evitare di danneggiarla.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente tiepida per 3 minuti. Se il componente rimane immerso per più di 3 minuti, aumentare il tempo di risciacquo in proporzione.</p> <p style="text-align: right;"><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



## PULIZIA DELLA VIDEOCAMERA QC (CON SALVIETTE)

!		<p>Prima di pulirlo, il componente deve essere preparato. Per le istruzioni, consultare <a href="#">Preparazione della videocamera per la pulizia a pagina 32</a>.</p>
1		<p><b>Pulire il componente strofinandolo con le salviette.</b> Strofinare nuovamente il componente con le salviette ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare tutte le salviette necessarie. Per istruzioni specifiche, consultare <a href="#">Tabella 11 a pagina 38</a>. (Queste informazioni variano a seconda delle salviette utilizzate.)</p>
2		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa. Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 1.</p>
3		<p><b>Asciugare il componente.</b> Lasciarlo asciugare bene all'aria.</p>
4		<p><b>Disinfettare il componente (facoltativo).</b> Per la disinfezione, procedere con <a href="#">Disinfezione della videocamera QC (facoltativa) a pagina 39</a>. Altrimenti, conservare il dispositivo in un ambiente pulito.</p>



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (SALVIETTE)

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 11. Salviette per la pulizia della videocamera QC

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviettine germicide AF3 Sani- Cloth	Pulizia	2.000	Pulire il componente seguendo le istruzioni del produttore del prodotto chimico. <b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



## PROCEDURA 3. DISINFEZIONE DELLA VIDEOCAMERA QC (FACOLTATIVA)



### AVVERTENZA

Accertarsi che ogni componente sia completamente pulito, prima di disinfeztarlo o sterilizzarlo. Se non lo è, la procedura di disinfezione o sterilizzazione potrebbe non rimuovere tutti gli agenti contaminanti, con conseguente aumento del rischio di infezione.



Leggere la sezione [Avvertenze e precauzioni](#) prima di eseguire la seguente operazione.

### PRIMA DI INIZIARE


Prima di iniziare la procedura di disinfezione del componente, assicurarsi di svolgere le seguenti azioni:

- Pulire il componente secondo le istruzioni e gli standard descritti nella sezione precedente, [Pulizia della videocamera QC](#).
- **Non posizionare i cappucci protettivi sui connettori della videocamera QC.** Questo componente è progettato per essere immerso completamente, senza l'utilizzo di cappucci protettivi, che Verathon peraltro non fornisce.




## DISINFEZIONE DELLA VIDEOCAMERA QC (CON SALVIETTE)

1




Pulire il componente strofinandolo con le salviette.  
Strofinare nuovamente il componente con le salviette ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare tutte le salviette necessarie.  
Per istruzioni specifiche, consultare Tabella 12 a pagina 41. (Queste informazioni variano a seconda delle salviette utilizzate.)

2




Asciugare il componente.  
Lasciarlo asciugare bene all'aria.

3



Esaminare il componente per accertarsi che non sia danneggiato.  
Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura.  
Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.

4



Conservare il componente in un ambiente pulito.



### AVVERTENZA

Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il dispositivo funzioni correttamente e non siano presenti danni. Non utilizzare questo prodotto, se il dispositivo risulta danneggiato. Rivolgersi al personale qualificato per la riparazione.

Assicurarsi sempre che siano immediatamente disponibili altri metodi e apparecchi per la gestione delle vie aeree.

Riferire qualsiasi possibile difetto all'Assistenza clienti Verathon. Per informazioni di contatto, visitare la pagina [verathon.com/global-support](http://verathon.com/global-support).



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 12. Salviette disinfettanti per la videocamera QC

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviettine germicide AF3 Sani- Cloth	Basso	2.000	<p><b>Esposizione:</b> strofinare tutte le superfici del componente con salviette pulite e lasciare agire per 3 minuti.</p> <p><b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria.</p> <p><b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

# VIDEO LARINGOSCOPI RIUTILIZZABILI TITANIUM



Leggere la sezione **Avvertenze e precauzioni** prima di eseguire le operazioni descritte in questa sezione.

## IMPORTANTE

Non lasciare che eventuali agenti contaminanti si depositino a lungo sul dispositivo. Una volta incrostatati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere.

Quando si utilizzano i disinfettanti elencati nel presente manuale, leggere e attenersi alle istruzioni per l'uso del prodotto in tutte le applicazioni.

*Nota: si presuppone che tutti i componenti elencati nella tabella seguente siano utilizzati come previsto.*

*Tabella 13. Requisiti di ricondizionamento per video laringoscopi riutilizzabili Titanium*

DISPOSITIVO	LIVELLI DI RICONDIZIONAMENTO RICHIESTI			
	Pulizia	Basso	Alto	Sterilizzazione
Video laringoscopio			✓	

*I livelli di ricondizionamento mostrati in questa tabella si riferiscono alle classificazioni CDC/Spaulding.*

## IMPORTANTE

Le informazioni sui prodotti di ricondizionamento materialmente compatibili ed efficaci sono disponibili nella tabella della pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts). Esaminare queste informazioni, prima di eseguire le procedure descritte in questo capitolo.



## ATTENZIONE

I componenti riutilizzabili dei sistemi GlideScope non sono spediti in condizioni sterili. Prima del primo utilizzo, è dunque necessario pulirli e disinfettarli o sterilizzarli, se opportuno. In caso contrario, aumenta il rischio di infezione.

## COMPONENTI TRATTATI IN QUESTA SEZIONE

Questa sezione del manuale contiene le istruzioni di ricondizionamento per i componenti seguenti:



## PROCEDURA 1. PREPARAZIONE DI UN VIDEO LARINGOSCOPIO RIUTILIZZABILE PER LA PULIZIA

1



Accertarsi che il monitor sia stato spento.

2



Scollegare il cavo video.

- Monitor video GlideScope: ruotare l'anello connettore nella direzione indicata dalla freccia, quindi tirare.
- Monitor Core: tenere il connettore in una mano e sostenere il monitor con l'altra, quindi tirare.


3



Scollegare il video laringoscopio.

Ruotare l'anello connettore nella direzione indicata dalla freccia di rilascio, quindi tirare.

4




Applicare un pre-detergente (facoltativo).

Una volta incrostatati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere.

Per informazioni sui pre-detergenti compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

5



Pulire il componente.

Continuare con [Pulizia del video laringoscopio riutilizzabile Titanium](#) a pagina 46.



## NOTE

## PROCEDURA 2. PULIZIA DEL VIDEO LARINGOSCOPIO RIUTILIZZABILE TITANIUM




Leggere la sezione [Avvertenze e precauzioni](#) prima di eseguire la seguente operazione.

*Nota: nell'eseguire questa procedura, manipolare con cautela il componente per evitare la ricontaminazione.*

### PULIZIA DEL VIDEO LARINGOSCOPIO RIUTILIZZABILE TITANIUM (CON UN PRODOTTO LIQUIDO)

#### IMPORTANTE


Dopo la pulizia con Metrex CaviCide, risciacquare accuratamente il componente come indicato nel presente manuale al fine di ridurre il rischio di lasciare residui citotossici.



Prima di pulirlo, il componente deve essere preparato.

Per le istruzioni, consultare [Preparazione di un video laringoscopio riutilizzabile per la pulizia a pagina 44](#).

**1**




Sciacquare il componente in acqua del rubinetto pulita.

Con un cotton fioc, rimuovere ogni traccia visibile di agenti contaminanti dagli angoli accanto alla punta e alla finestra della videocamera, come mostrato nella figura sulla sinistra. Strofinare il resto del componente con una spazzola a setole morbide.

Per rimuovere gli agenti contaminanti dai connettori, utilizzare uno spazzolino lungo a setole morbide o un cotton fioc.






**2**




Preparare la soluzione detergente.

Per la concentrazione, la temperatura e altre istruzioni per la preparazione, consultare [Tabella 14 a pagina 50](#).



3		<p><b>Lavare il componente</b> nella soluzione detergente. Strofinare gli angoli accanto alla punta e alla finestra della videocamera come fatto nel Fase 1.</p> <p>Per il tempo di esposizione, la temperatura e altre istruzioni per il lavaggio, consultare <a href="#">Tabella 14 a pagina 50</a>. (Queste informazioni variano a seconda della soluzione detergente utilizzata.)</p>
4		<p><b>Sciacquare il componente</b> per rimuovere la soluzione detergente.</p> <p>Per il tempo di risciacquo, la temperatura e altre istruzioni per il risciacquo, consultare <a href="#">Tabella 14 a pagina 50</a>. (Queste informazioni variano a seconda della soluzione detergente utilizzata.)</p>
5		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa.</p> <p>Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 3.</p>
6		<p><b>Asciugare il componente.</b></p> <p>Utilizzare aria pulita di tipo ospedaliero per soffiare via l'umidità residua dai connettori, quindi asciugare il componente con uno dei metodi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aria pulita di tipo ospedaliero</li><li>• un panno pulito che non lascia pelucchi</li></ul>
7		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che non sia danneggiato.</p> <p>Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura.</p> <p>Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.</p>

8



**Disinfettare o sterilizzare il componente.**

Per la disinfezione, procedere con [Disinfezione del video laringoscopio riutilizzabile Titanium a pagina 56](#).

La sterilizzazione è facoltativa. Per la sterilizzazione, procedere con [Sterilizzazione del video laringoscopio riutilizzabile Titanium \(facoltativa\) a pagina 66](#).



**ATTENZIONE**

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfettati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (PRODOTTI LIQUIDI)

Verathon ha convalidato la compatibilità chimica e l'efficacia biologica dei prodotti specificati in questa tabella per la pulizia dei componenti indicati secondo le istruzioni elencate nella colonna Condizioni.

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 14. Soluzioni detergenti per video laringoscopi riutilizzabili Titanium

PRODOTTO	LIVELLO	CICLI*	CONDIZIONI
Getinge Tec Wash III	Pulizia	3.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente a una temperatura di 20–40 °C (68–104 °F) e in una concentrazione di 2–8 ml/l (0,25–1 once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per 3 minuti. Spazzolare tutte le superfici del componente.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente per 3 minuti.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Prodotto enzimatico concentrato per la pulizia e la pre-immersione STERIS eSENTIALS	Pulizia	3.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente a una temperatura di 30–40 °C (86–104 °F) e in una concentrazione di 1–8 ml/l (0,125–1 once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per 5 minuti. Prima di rimuovere il componente dalla soluzione, spazzolarne tutte le superfici. Quando si spazzola il componente, prestare particolare attenzione alle zone più difficili da raggiungere. Sciacquare il connettore utilizzando una siringa.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente per 3 minuti. Sciacquare il connettore utilizzando una siringa.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
STERIS Prolystica 2X Prodotto enzimatico concentrato per la pulizia e la pre-immersione <sup>†</sup>	Pulizia	3.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente a una temperatura di 35 °C±5°C e in una concentrazione di 1–4 ml/l (0,125–0,5 once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per almeno 3 minuti. Prima di rimuovere il componente dalla soluzione, utilizzare un cotton fioc per pulire la finestra della videocamera, quindi spazzolare tutte le superfici con uno spazzolino a setole morbide. Quando si spazzola il componente, prestare particolare attenzione alle zone più difficili da raggiungere.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente tiepida per 3 minuti. Se il componente rimane immerso per più di 3 minuti, aumentare il tempo di risciacquo in proporzione.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>



Tabella 14. Soluzioni detergenti per video laringoscopi riutilizzabili Titanium

PRODOTTO	LIVELLO	CICLI*	CONDIZIONI
Metrex CaviCide	Pulizia	3.000	<p><b>Esposizione:</b> utilizzando la soluzione detergente a una temperatura di 33–40 °C (91–104 °F) e alla massima concentrazione, spruzzarla su tutte le superfici, in modo da bagnarle bene. Lasciare agire la soluzione sul componente per 3 minuti. Spazzolare tutte le superfici del componente.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente per 5 minuti. Durante questa fase, utilizzare una spazzola a setole morbide e una siringa per arrivare anche nelle zone più difficili da raggiungere.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Metrex EmPower	Pulizia	3.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente a una temperatura di 19–29 °C (66–84 °F) e in una concentrazione di 7,8 ml/l (1 oncia di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per 3 minuti. Prima di rimuovere il componente dalla soluzione, spazzolare tutte le superfici e prestare particolare attenzione alle zone più difficili da raggiungere.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente per 3 minuti.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Detergente enzimatico Ecolab	Pulizia	3.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente a una temperatura di 35 °C±5°C e in una concentrazione di 3,9–15,6 ml/l (0,5-2 once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per 1-5 minuti, strofinandone le superfici tranne la finestra della videocamera con una spazzola a setole morbide, per rimuovere qualsiasi traccia di contaminazione residua. Pulire la finestra della videocamera utilizzando un cotton fioc per evitare di graffiare il vetro.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente per 3 minuti e spazzolarne tutte le superfici tranne la finestra della videocamera con una spazzola a setole morbide. Strofinare la finestra della videocamera utilizzando un cotton fioc per evitare di graffiare il vetro.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>



Tabella 14. Soluzioni detergenti per video laringoscopi riutilizzabili Titanium

PRODOTTO	LIVELLO	CICLI*	CONDIZIONI
Schiuma detergente Ecolab OptiPro Multi - Enzymatic Low	Pulizia	3.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente con una concentrazione pari a 3,9–15,6 ml/l (0,5–2 once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per 2–5 minuti. Successivamente, spazzolare tutte le superfici del componente tranne la finestra della videocamera con una spazzola a setole morbide, per rimuovere qualsiasi traccia visibile di agente contaminante. Pulire la finestra della videocamera con un cotton fioc.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua fredda corrente per 3 minuti e spazzolarne tutte le superfici tranne la finestra della videocamera con una spazzola a setole morbide. Utilizzare un cotton fioc per strofinare la finestra della videocamera.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Pro-Line Solutions EcoZyme	Pulizia	3.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente a una temperatura di 30-40 °C (86-104 °F) e in una concentrazione di 7,8 ml/l (1 oncia di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per 5 minuti. Prima di rimuovere il componente dalla soluzione, spazzolarne tutte le superfici e prestare particolare attenzione alle zone più difficili da raggiungere. Sciacquare il connettore utilizzando una siringa.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente a una temperatura di 19–29 °C (66–84 °F) per 5 minuti. Sciacquare il connettore utilizzando una siringa.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.


† Dopo aver utilizzato STERIS Prolystica 2X Concentrate per pulire un componente che viene a contatto diretto con il paziente, è necessario disinfezione o sterilizzare quest'ultimo come descritto nel presente manuale. Il passaggio di disinfezione o sterilizzazione neutralizza eventuali enzimi rimanenti e previene la citotossicità.

# PULIZIA DEL VIDEO LARINGOSCOPIO RIUTILIZZABILE TITANIUM (CON SALVIETTE)



!		<p>Prima di pulirlo, il componente deve essere preparato. Per le istruzioni, consultare <a href="#">Preparazione di un video laringoscopio riutilizzabile per la pulizia</a> a pagina 44.</p>
1		<p><b>Pulire il componente strofinandolo con le salviette.</b> Strofinare nuovamente il componente con le salviette ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare tutte le salviette necessarie. Per istruzioni specifiche, consultare <a href="#">Tabella 15</a> a pagina 55. (Queste informazioni variano a seconda delle salviette utilizzate.)</p>
2		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa. Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 1.</p>
3		<p><b>Asciugare il componente.</b> Lasciarlo asciugare bene all'aria.</p>
4		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che non sia danneggiato. Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura. Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.</p>

5



**Disinfettare o sterilizzare il componente.**

Per la disinfezione, procedere con [Disinfezione del video laringoscopio riutilizzabile Titanium a pagina 56](#).

La sterilizzazione è facoltativa. Per la sterilizzazione, procedere con [Sterilizzazione del video laringoscopio riutilizzabile Titanium \(facoltativa\) a pagina 66](#).



**ATTENZIONE**

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfettati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (SALVIETTE)

Verathon ha convalidato la compatibilità chimica e l'efficacia biologica dei prodotti specificati in questa tabella per la pulizia dei componenti indicati secondo le istruzioni elencate nella colonna Condizioni.

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 15. Salviette detergenti per video laringoscopi riutilizzabili Titanium

PRODOTTO	LIVELLO	CICLI*	CONDIZIONI
Sistema di salviette Tristel Trio	Pulizia	3.000	<p><b>Esposizione:</b> utilizzare 2 o più salviette di pre-pulizia per rimuovere ogni traccia visibile di contaminazione dal componente.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.

## PROCEDURA 3. DISINFEZIONE DEL VIDEO LARINGOSCOPIO RIUTILIZZABILE TITANIUM



### AVVERTENZA

Accertarsi che ogni componente sia completamente pulito, prima di disinfezionarlo o sterilizzarlo. Se non lo è, la procedura di disinfezione o sterilizzazione potrebbe non rimuovere tutti gli agenti contaminanti, con conseguente aumento del rischio di infezione.



Leggere la sezione [Avvertenze e precauzioni](#) prima di eseguire la seguente operazione.

Prima di ciascun utilizzo è necessario sottoporre i video laringoscopi riutilizzabili a una disinfezione ad alto livello. Attenersi a questa procedura per disinfezionare il video laringoscopio riutilizzabile GlideScope Titanium.

### PRIMA DI INIZIARE


Prima di iniziare la procedura di disinfezione del componente, assicurarsi di svolgere le seguenti azioni:

- Pulire il componente secondo le istruzioni e gli standard descritti nella sezione precedente, [Pulizia del video laringoscopio riutilizzabile Titanium](#).
- Non posizionare i cappucci protettivi sui connettori dei video laringoscopi GlideScope Titanium. Tali componenti sono progettati per essere immersi completamente, senza l'utilizzo di cappucci protettivi, che Verathon peraltro non fornisce.



## DISINFEZIONE DEL VIDEO LARINGOSCOPIO RIUTILIZZABILE TITANIUM (CON UN PRODOTTO LIQUIDO)


**1**



Preparare la soluzione disinfettante.

Per la concentrazione, la temperatura e altre istruzioni per la preparazione, consultare [Tabella 16 a pagina 60](#).


**2**



Esporre il componente alla soluzione disinfettante.

Per il tempo di esposizione, la temperatura e altre istruzioni specifiche, consultare [Tabella 16 a pagina 60](#). (Queste informazioni variano a seconda del disinfettante utilizzato.)


**3**



Sciacquare il componente per rimuovere la soluzione disinfettante.

Per il tempo di risciacquo, la temperatura e altre istruzioni per il risciacquo, consultare [Tabella 16 a pagina 60](#). (Queste informazioni variano a seconda del disinfettante utilizzato.)

**4**




Asciugare il componente.

Utilizzare aria pulita di tipo ospedaliero per soffiare via l'umidità residua dai connettori, quindi asciugare il componente con uno dei metodi seguenti:

- aria pulita di tipo ospedaliero
- un panno pulito che non lascia pelucchi

**5**




**Esaminare il componente** per accertarsi che non sia danneggiato.

Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura.

Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.

**6**



**Conservare il componente** in un ambiente pulito.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (PRODOTTI LIQUIDI)

Verathon ha convalidato la compatibilità chimica e l'efficacia biologica dei prodotti nella [Tabella 16](#) per la disinfezione dei componenti indicati secondo le istruzioni elencate nella colonna Condizioni.

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

### IMPORTANTE

Quando si effettua una disinfezione ad alto livello su un video laringoscopio riutilizzabile Titanium, si può utilizzare un sistema Cantel (MEDIVATORS) CER Optima 1 & 2 AER, DSD-201 AER o SSD-102 AER, a condizione che vengano rispettati i requisiti riportati di seguito:

- Utilizzare uno dei disinfettanti ad alto livello di disinfezione indicati nella [Tabella 16](#).
- Utilizzare un disinfettante compatibile con il sistema Cantel. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità chimica, contattare Cantel.
- Seguire le condizioni di condizionamento fornite nella [Tabella 16](#), tra cui temperatura, esposizione e concentrazione per il prodotto disinfettante che si intende utilizzare.
- Non esporre il componente a temperature superiori a 60 °C (140 °F) durante i cicli.

Nella tabella seguente, con il termine *acqua distillata* si intende il tipo di acqua idoneo alla disinfezione, in conformità alle normative locali e al regolamento della struttura sanitaria in cui si opera.

*Tabella 16. Soluzioni disinettanti per video laringoscopi riutilizzabili Titanium*

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
STERIS S40 o S20	Alto	650	<p>Utilizzare i cicli standard nei seguenti processori:</p> <p>SYSTEM 1E (negli Stati Uniti)      STERIS SYSTEM 1 (fuori dagli Stati Uniti)      SYSTEM 1 EXPRESS (fuori dagli Stati Uniti)      SYSTEM 1 PLUS (fuori dagli Stati Uniti)</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
STERIS Resert XL HLD <sup>†</sup> Revital-Ox Resert XL HLD <sup>†</sup> Revital-Ox Resert HLD/ Chemosterilant <sup>‡</sup>	Alto	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 8 minuti, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente una volta per 1 minuto in acqua distillata, mantenendolo in agitazione. Verificare che il connettore sia stato risciacquato correttamente.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Disinfettante OPA ASP CIDEX	Alto	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 12 minuti, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria. Utilizzare la soluzione alla massima concentrazione.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
ASP CIDEX PLUS	Alto	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente per 20 minuti a 25 °C (77 °F), accertandosi che sulla sua superficie non rimangano bollicine d'aria.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente in acqua distillata a 33 - 40 °C (91 - 104 °F). Immergerlo 3 volte, ciascuna volta per 3 minuti, durante i quali lo si agita, lo si sciacqua e lo si strofina con una spazzola sterile a setole morbide.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>



Tabella 16. Soluzioni disinfettanti per video laringoscopi riutilizzabili Titanium

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Metrex MetriCide Plus 30	Alto	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente per 20 minuti a 25 °C (77 °F), accertandosi che sulla sua superficie non rimangano bollicine d'aria.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente in acqua distillata a 33–40 °C (91–104 °F). Immergerlo 3 volte, ciascuna volta per 3 minuti, durante i quali lo si agita, lo si sciacqua e lo si strofina con una spazzola sterile a setole morbide.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Metrex MetriCide OPA Plus	Alto	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 12 minuti, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Cantel (MEDIVATORS) Rapicide OPA/28	Alto	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 12 minuti, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Anios OPASTER'ANIOS/ Farmec OPASTER	Alto	3.000 (tranne LoPro T2)	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente per 30 minuti a temperatura ambiente, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria. Utilizzare la soluzione alla massima concentrazione.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione. Accertarsi che tutti i connettori esposti siano sciacquati correttamente.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>



Tabella 16. Soluzioni disinettanti per video laringoscopi riutilizzabili Titanium

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Metrex MetriCide 28	Alto	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente per 20 minuti a 25 °C (77 °F), accertandosi che sulla sua superficie non rimangano bollicine d'aria.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente in acqua distillata a 33–40 °C (91–104 °F). Immergerlo 3 volte, ciascuna volta per 3 minuti, durante i quali lo si agita, lo si sciacqua e lo si strofina con una spazzola sterile a setole morbide.</p> <p><b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Soluzione dialdeide attivata (ADS) ASP CIDEX	Alto	1.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente per 45 minuti a 25 °C (77 °F), accertandosi che sulla sua superficie non rimangano bollicine d'aria.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente in acqua distillata a 33–40 °C (91–104 °F). Immergerlo 3 volte, ciascuna volta per 3 minuti, durante i quali lo si agita, lo si sciacqua e lo si strofina con una spazzola sterile a setole morbide.</p> <p><b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Cantel (MEDIVATORS) Rapicide PA 30 °C	Alto	100	<p><b>Concentrazione:</b> 850±100 parti per milione</p> <p><b>Esposizione:</b> condizionare il componente per 5 minuti a 30 °C (86 °F) in un sistema Cantel Advantage Plus o DSD Edge AER con la configurazione seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Collegamento: 2-8-002HAN Rev. B</li><li>• Parametro: 1-24-010 C DISF</li></ul> <p><b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>






\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.

† Questo prodotto chimico può causare lo scolorimento dei componenti in metallo. Tuttavia, questo effetto non influisce sulla funzionalità o l'efficacia del sistema.



## NOTE

## DISINFEZIONE DEL VIDEO LARINGOSCOPIO RIUTILIZZABILE TITANIUM (CON SALVIETTE)

1		<p><b>Pulire il componente strofinandolo con le salviette.</b> Strofinare nuovamente il componente con le salviette ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare tutte le salviette necessarie. Per istruzioni specifiche, consultare <a href="#">Tabella 17 a pagina 65</a>. (Queste informazioni variano a seconda delle salviette utilizzate.)</p>
2		<p><b>Sciacquare il componente</b> per rimuovere ogni residuo di disinfettante, se necessario. Per stabilire se con le salviette utilizzate è necessario procedere al risciacquo, consultare la <a href="#">Tabella 17 a pagina 65</a>.</p>
3		<p><b>Asciugare il componente.</b> Lasciarlo asciugare bene all'aria.</p>
4		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che non sia danneggiato. Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura. Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.</p>
5		<p><b>Conservare il componente</b> in un ambiente pulito.</p>



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (SALVIETTE)

Verathon ha convalidato la compatibilità chimica e l'efficacia biologica dei prodotti nella **Tabella 17** per la disinfezione dei componenti indicati secondo le istruzioni elencate nella colonna Condizioni.

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

*Tabella 17. Salviette disinfettanti per video laringoscopi riutilizzabili Titanium*

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Sistema di salviette Tristel Trio	Alto	3.000	<p><b>Esposizione:</b> eseguire 2 applicazioni della schiuma attivatore su una salvietta sporicida e manipolarla per 15 secondi. Bagnare tutte le superfici del componente e lasciare agire per 30 secondi.</p> <p><b>Risciacquo:</b> utilizzare una salvietta per il risciacquo per pulire tutte le superfici del componente.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.

## PROCEDURA 4. STERILIZZAZIONE DEL VIDEO LARINGOSCOPIO RIUTILIZZABILE TITANIUM (FACOLTATIVA)



### AVVERTENZA

Accertarsi che ogni componente sia completamente pulito, prima di disinfeccarlo o sterilizzarlo. Se non lo è, la procedura di disinfezione o sterilizzazione potrebbe non rimuovere tutti gli agenti contaminanti, con conseguente aumento del rischio di infezione.



### ATTENZIONE

Non esporre il componente del sistema GlideScope a temperature superiori a 60 °C (140 °F), né utilizzare autoclavi o altri sistemi di sterilizzazione termici diversi da quelli descritti nel presente manuale. L'esposizione a calore eccessivo danneggia irreparabilmente il dispositivo e comporta l'annullamento della garanzia.



Leggere la sezione [Avvertenze e precauzioni](#) prima di eseguire le operazioni seguenti.

La sterilizzazione del video laringoscopio riutilizzabile Titanium è facoltativa. Tuttavia, è possibile che la struttura sanitaria o il fornitore richiedano la sterilizzazione dei componenti in questione prima dell'utilizzo. Attenersi a questa procedura per sterilizzare il video laringoscopio riutilizzabile GlideScope Titanium.





## PRIMA DI INIZIARE

Prima di iniziare la procedura di sterilizzazione del componente, assicurarsi di svolgere le seguenti azioni:

- Pulire il componente secondo le istruzioni e gli standard descritti nella sezione precedente, [Pulizia del video laringoscopio riutilizzabile Titanium](#).
- Al termine della pulizia, ispezionare il componente come descritto nella sezione [Pulizia del video laringoscopio riutilizzabile Titanium](#). Se si riscontrano danni che superano la normale usura, non riutilizzarlo e contattare l'Assistenza clienti Verathon.
- **Non** posizionare i cappucci protettivi sui connettori dei video laringoscopi GlideScope Titanium. Questi componenti sono progettati per essere sterilizzati senza l'utilizzo di cappucci protettivi, che Verathon peraltro non fornisce.



## STERILIZZAZIONE DEL VIDEO LARINGOSCOPIO RIUTILIZZABILE TITANIUM

1		<p><b>Confezionare il componente</b> in una busta, materiale avvolgente o altro contenitore, se opportuno.</p> <p>Per il tipo di confezionamento opportuno per il sistema di sterilizzazione in uso, fare riferimento alle istruzioni del produttore e alla <a href="#">Tabella 18 a pagina 68</a>.</p>
2		<p><b>Sterilizzare il componente.</b></p> <p>Per le impostazioni del ciclo compatibile e altre informazioni specifiche, fare riferimento alla <a href="#">Tabella 18 a pagina 68</a>. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni del produttore del sistema di sterilizzazione.</p>
3		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che non sia danneggiato.</p> <p>Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura.</p> <p>Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.</p>
4		<p><b>Conservare il componente</b> in un ambiente idoneo per apparecchiature sterili.</p>

## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO

Verathon ha convalidato la compatibilità chimica e l'efficacia biologica dei prodotti specificati in questa tabella per la sterilizzazione dei componenti indicati secondo le istruzioni elencate nella colonna Condizioni.

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 18. Prodotti sterilizzanti per video laringoscopi riutilizzabili Titanium

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
STERIS S40 o S20	Sterilizzazione	650	Non è necessario il confezionamento. Utilizzare i cicli standard nei seguenti processori: SYSTEM 1E (negli Stati Uniti) STERIS SYSTEM 1 (fuori dagli Stati Uniti) SYSTEM 1 EXPRESS (fuori dagli Stati Uniti) SYSTEM 1 PLUS (fuori dagli Stati Uniti) <b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
Sistemi STERIS V-PRO con Vaprox HC	Sterilizzazione	125	Inserire il componente in una busta Tyvek, quindi attivare il ciclo non-lumen in uno dei sistemi di sterilizzazione a bassa temperatura STERIS Amsco V-PRO. <b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
Sterilizzatore al perossido di idrogeno Gas Plasma ASP	Sterilizzazione	300	Inserire il componente in una busta Tyvek, quindi sterilizzarlo in uno dei seguenti processori: STERRAD 100S (per gli Stati Uniti) STERRAD 100S ciclo corto (fuori dagli Stati Uniti) STERRAD NX ciclo standard STERRAD 100NX ciclo standard STERRAD 50 STERRAD 200 ciclo corto <b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



# MONITOR GLIDESCOPE CORE, POSTAZIONE DI LAVORO, E ALIMENTATORE



Leggere la sezione **Avvertenze e precauzioni** prima di eseguire le operazioni descritte in questa sezione.

Le procedure di pulizia del monitor GlideScope Core costituiscono un aspetto estremamente importante per l'utilizzo e la manutenzione dello stesso. Prima di ciascun utilizzo, accertarsi che il monitor sia stato pulito secondo le linee guida fornite in **Tabella 19**.

La disponibilità e la conformità normativa dei prodotti di pulizia forniti nel presente manuale variano in base all'area; verificare di selezionare i prodotti conformemente alle normative e legislazioni locali.

## IMPORTANTE

Non lasciare che eventuali agenti contaminanti si depositino a lungo sul dispositivo. Una volta incrostati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere.

Quando si utilizzano i disinfettanti elencati nel presente manuale, leggere e attenersi alle istruzioni per l'uso del prodotto in tutte le applicazioni.

*Tabella 19. Requisiti di ricondizionamento per i monitor GlideScope Core*

DISPOSITIVO	LIVELLI DI RICONDIZIONAMENTO RICHIESTI			
	Pulizia	Basso	Alto	Sterilizzazione
Monitor	✓			


*I livelli di ricondizionamento mostrati in questa tabella si riferiscono alle classificazioni CDC/Spaulding.*

## IMPORTANTE


Le informazioni sui prodotti di ricondizionamento materialmente compatibili ed efficaci sono disponibili nella tabella della pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts). Esaminare queste informazioni, prima di eseguire le procedure descritte in questo capitolo.

## COMPONENTI TRATTATI IN QUESTA SEZIONE

Questa sezione del manuale contiene le istruzioni di ricondizionamento per i componenti seguenti:

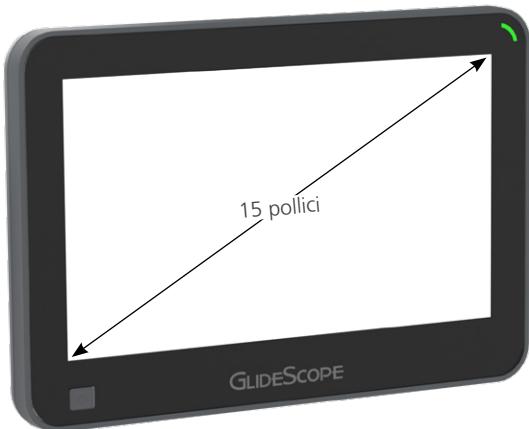

Monitor GlideScope Core 15

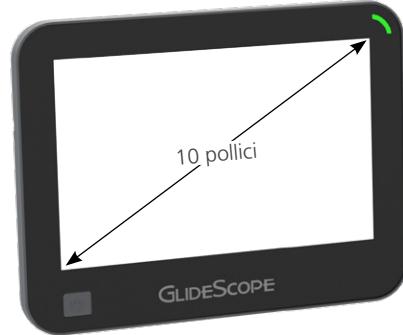

Monitor GlideScope Core 10



Postazione di lavoro GlideScope Core Premium



Adattatore GlideScope Core



## PROCEDURA 1. PULIZIA DEL MONITOR GLIDESCOPE CORE




### AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di elettrocuzione, prima di pulire il monitor o la postazione di lavoro, spegnere il monitor e scollegare l'alimentazione. Scollegare la spina di alimentazione dalla sorgente di corrente CA.

### IMPORTANTE


Durante la pulizia dello schermo del monitor video, non utilizzare sostanze abrasive, spazzole, spugne o strumenti onde evitare di graffiarne la superficie, causando un danno permanente al dispositivo.

**1**



Accertarsi che il monitor sia stato spento, quindi scollegare il suo adattatore.

**2**



Strofinare le superfici esterne del monitor con una soluzione compatibile.

Per un elenco delle soluzioni compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Per istruzioni specifiche su pulizia e uso, consultare le istruzioni del produttore della soluzione.

## PROCEDURA 2. PULIZIA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO E DELL'ADATTATORE GLIDESCOPE CORE



### AVVERTENZA


Pericolo di scosse elettriche. Non immergere in acqua l'adattatore. Piuttosto, utilizzare un panno inumidito di alcool isopropilico per pulire le parti esterne dell'adattatore.

**1**



Accertarsi che il monitor sia stato spento, quindi scollegare il suo adattatore.

**2**



Strofinare le superfici esterne della postazione di lavoro e dell'adattatore con una soluzione compatibile.

Per un elenco delle soluzioni compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Per istruzioni specifiche su pulizia e uso, consultare le istruzioni del produttore della soluzione.



# MONITOR E BASE DI RICARICA GLIDESCOPE GO



Leggere la sezione **Avvertenze e precauzioni** prima di eseguire le operazioni descritte in questa sezione.

## IMPORTANTE

Non lasciare che eventuali agenti contaminanti si depositino a lungo sul dispositivo. Una volta incrostatati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere.

Quando si utilizzano i disinfettanti elencati nel presente manuale, leggere e attenersi alle istruzioni per l'uso del prodotto in tutte le applicazioni.

*Nota: si presuppone che tutti i componenti elencati nella tabella seguente siano utilizzati come previsto.*

Tabella 20. Requisiti di ricondizionamento per monitor GlideScope Go

DISPOSITIVO	LIVELLI DI RICONDIZIONAMENTO RICHIESTI			
	Pulizia	Basso	Alto	Sterilizzazione
Monitor	✓			

*I livelli di ricondizionamento mostrati in questa tabella si riferiscono alle classificazioni CDC/Spaulding.*

## IMPORTANTE

Le informazioni sui prodotti di ricondizionamento materialmente compatibili ed efficaci sono disponibili nella tabella della pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts). Esaminare queste informazioni, prima di eseguire le procedure descritte in questo capitolo.

## COMPONENTI TRATTATI IN QUESTA SEZIONE

Questa sezione del manuale contiene le istruzioni di ricondizionamento per i componenti seguenti:



Monitor GlideScope Go



Base di ricarica GlideScope Go



## PROCEDURA 1. PREPARAZIONE DEL MONITOR GLIDESCOPE GO PER LA PULIZIA

I video laringoscopi monouso Spectrum sono dispositivi sterili e monouso. La lama Stat GVL è un dispositivo monouso e sterile. Dopo l'uso è necessario rimuovere e smaltire entrambi i tipi di dispositivi come previsto dai protocolli locali, poiché rappresentano un rischio biologico.

1		Accertarsi che il monitor sia stato spento.
2		Scollegare il video laringoscopio o la videocamera. Afferrare il laringoscopio o la camera in una mano e il connettore HDMI collegato nell'altra. Tirare con decisione per separare i due dispositivi.
3		Pulire il monitor. Continuare con <a href="#">Pulizia del monitor GlideScope Go a pagina 74</a> .

## PROCEDURA 2. PULIZIA DEL MONITOR GLIDESCOPE GO



### ATTENZIONE

I componenti riutilizzabili dei sistemi GlideScope non sono spediti in condizioni sterili. Prima del primo utilizzo, è dunque necessario pulirli e disinfecciarli o sterilizzarli, se opportuno. In caso contrario, aumenta il rischio di infezione.



Pulire il monitor dopo ciascun utilizzo, seguendo le istruzioni riportate più in basso. Verathon ha convalidato la compatibilità e l'efficacia dei prodotti e del metodo riportati a seguire. Per informazioni riguardo eventuali ulteriori soluzioni disponibili, contattare l'Assistenza clienti Verathon.



## PULIZIA DEL MONITOR GLIDESCOPE GO (CON UN PRODOTTO LIQUIDO)

!		<p>Prima di pulirlo, il componente deve essere preparato.</p> <p>Per le istruzioni, consultare <a href="#">Preparazione del monitor GlideScope Go per la pulizia a pagina 74</a>.</p>
1		<p>Preparare la soluzione detergente.</p> <p>Per la concentrazione, la temperatura e altre istruzioni per la preparazione, consultare <a href="#">Tabella 21 a pagina 77</a>.</p>
2		<p>Lavare il componente nella soluzione detergente.</p> <p>Per il tempo di esposizione, la temperatura e altre istruzioni per il lavaggio, consultare <a href="#">Tabella 21 a pagina 77</a>.</p> <p>Per la pulizia del pulsante di accensione/spegnimento, della porta micro USB e delle scanalature intorno alla finestra LCD e al braccio del connettore, utilizzare un cotton fioc inumidito con la soluzione detergente.</p>
3		<p>Sciacquare il componente per rimuovere la soluzione detergente.</p> <p>Per il tempo di risciacquo, la temperatura e altre istruzioni per il risciacquo, consultare <a href="#">Tabella 21 a pagina 77</a>.</p>
4		<p>Esaminare il componente per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa.</p> <p>Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 2.</p>



5		<b>Asciugare il componente</b> con un panno pulito che non lascia pelucchi.
6		<b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che non sia danneggiato. Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura. Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.
7		<b>Disinfettare il componente</b> , se necessario. La disinfezione è facoltativa. Per la disinfezione, procedere con <a href="#">Disinfezione del monitor GlideScope Go (facoltativa)</a> a pagina 82.



### ATTENZIONE

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfettati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (PRODOTTI LIQUIDI)

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 21. Soluzioni detergenti per il monitor GlideScope Go

SOLUZIONE	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Detergente enzimatico ASP CIDEZYME (ENZOL)	Pulizia	1.500	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente con una concentrazione pari a 8–16 mL/L (1-2 once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per 1-3 minuti. Utilizzare un panno pulito che non lascia pelucchi o un cotton fioc per pulire il componente mentre è ancora immerso, facendo particolare attenzione all'area intorno al pulsante, al cardine, ai contorni di tutte le superfici e ai bordi.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente per 3 minuti. Accertarsi di sciacquare correttamente il connettore HDMI e il connettore micro USB.</p> <p>◀ <b>Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



## NOTE



## PULIZIA DEL MONITOR GLIDESCOPE GO (CON SALVIETTE)

!		<p>Prima di pulirlo, il componente deve essere preparato. Per le istruzioni, consultare <a href="#">Preparazione del monitor GlideScope Go per la pulizia</a> a pagina 74.</p>
1		<p><b>Pulire il componente strofinandolo con le salviette.</b> Strofinare nuovamente il componente con le salviette ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare tutte le salviette necessarie. Per istruzioni specifiche, consultare <a href="#">Tabella 22</a> a pagina 81. (Queste informazioni variano a seconda delle salviette utilizzate.)</p>
2		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa. Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 1.</p>
3		<p><b>Asciugare il componente.</b> Lasciarlo asciugare bene all'aria.</p>



4		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che non sia danneggiato.</p> <p>Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura.</p> <p>Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.</p>
5		<p><b>Disinfettare il componente</b>, se necessario.</p> <p>La disinfezione è facoltativa. Per la disinfezione, procedere con <a href="#">Disinfezione del monitor GlideScope Go (facoltativa)</a> a pagina 82.</p>



#### ATTENZIONE

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfettati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (SALVIETTE)

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 22. Salviette detergenti per il monitor GlideScope Go

SOLUZIONE	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviettine germicide AF3 usa e getta PDI Sani-Cloth	Pulizia	1.500	<p><b>Esposizione:</b> rimuovere tutti i segni visibili di contaminazione dal componente. Bagnare tutte le superfici del componente e mantenerle bagnate per almeno 3 minuti. Prestare particolare attenzione ai bordi e ai contorni delle superfici difficili da raggiungere.</p> <p><b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria.</p> <p>◀ <b>Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



## PROCEDURA 3. DISINFEZIONE DEL MONITOR GLIDESCOPE GO (FACOLTATIVA)



### AVVERTENZA

Accertarsi che ogni componente sia completamente pulito, prima di disinfezionarlo o sterilizzarlo. Se non lo è, la procedura di disinfezione o sterilizzazione potrebbe non rimuovere tutti gli agenti contaminanti, con conseguente aumento del rischio di infezione.



### ATTENZIONE

Non esporre il componente del sistema GlideScope a temperature superiori a 60 °C (140 °F), né utilizzare autoclavi o altri sistemi di sterilizzazione termici diversi da quelli descritti nel presente manuale. L'esposizione a calore eccessivo danneggia irreparabilmente il dispositivo e comporta l'annullamento della garanzia.

È possibile che la struttura sanitaria o il fornitore richiedano la disinfezione prima dell'utilizzo. Verathon ha convalidato la compatibilità e l'efficacia dei prodotti e del metodo riportati a seguire. Per informazioni riguardo ulteriori prodotti disponibili, contattare l'Assistenza clienti Verathon.

## PRIMA DI INIZIARE


Prima di iniziare la procedura di disinfezione del componente, assicurarsi di svolgere le seguenti azioni:

- Pulire il componente secondo le istruzioni e gli standard descritti nella sezione precedente, [Pulizia del monitor GlideScope Go](#).
- Non posizionare i cappucci protettivi sui connettori del monitor GlideScope Go. Il monitor è progettato per essere immerso completamente, senza l'utilizzo di cappucci protettivi che Verathon peraltro non fornisce.



## DISINFEZIONE DEL MONITOR GLIDESCOPE GO (CON UN PRODOTTO LIQUIDO)


1



Preparare la soluzione detergente.

Per la concentrazione, la temperatura e altre istruzioni per la preparazione, consultare [Tabella 23 a pagina 84](#).


2



Esporre il componente alla soluzione disinfettante.

Per il tempo di esposizione, la temperatura e altre istruzioni specifiche, consultare [Tabella 23 a pagina 84](#). (Queste informazioni variano a seconda del disinfettante utilizzato.)


3



Sciacquare il componente per rimuovere la soluzione disinfettante.

Per il tempo di risciacquo, la temperatura e altre istruzioni per il risciacquo, consultare [Tabella 23 a pagina 84](#). (Queste informazioni variano a seconda del disinfettante utilizzato.)


4



Asciugare il componente.

Lasciarlo asciugare bene all'aria.

5



Conservare il componente in un ambiente pulito.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (PRODOTTI LIQUIDI)

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Nella tabella seguente, con il termine *acqua distillata* si intende il tipo di acqua idoneo alla disinfezione, in conformità alle normative locali e al regolamento della struttura sanitaria in cui si opera.

Tabella 23. Soluzioni disinfettanti per il monitor GlideScope Go


SOLUZIONE	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Anios OPASTER'ANIOS/ Farmec OPASTER	Alto	1.500	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente per 30 minuti a temperatura ambiente, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria. Utilizzare la soluzione alla massima concentrazione.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione. Accertarsi di sciacquare correttamente il connettore HDMI e il connettore micro USB.</p> <p><b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Disinfettante OPA ASP CIDEX	Alto	1.500	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente per 12 minuti a temperatura ambiente, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria. Utilizzare la soluzione alla massima concentrazione.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione. Accertarsi di sciacquare correttamente il connettore HDMI e il connettore micro USB.</p> <p><b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.




## DISINFEZIONE DEL MONITOR GLIDESCOPE GO (CON SALVIETTE)

1




Pulire il componente strofinandolo con le salviette.  
Strofinare nuovamente il componente con le salviette  
ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente  
bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare  
tutte le salviette necessarie.  
Per istruzioni specifiche, consultare [Tabella 24](#) a pagina 86.  
(Queste informazioni variano a seconda delle  
salviette utilizzate.)

2



Asciugare il componente.  
Lasciarlo asciugare bene all'aria.

3



Conservare il componente in un ambiente pulito.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (SALVIETTE)

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 24. Salviette disinfettanti per il monitor GlideScope Go

SOLUZIONE	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviettine germicide AF3 usa e getta PDI Sani-Cloth	Basso	1.500	<p><b>Esposizione:</b> bagnare tutte le superfici del componente e mantenerle bagnate per 3 minuti. Prestare particolare attenzione alla zona intorno al cardine, ai contorni di tutte le superfici e a tutti i bordi.</p> <p><b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria.</p> <p><b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



## PROCEDURA 4. PULIZIA DELLA BASE DI RICARICA GLIDESCOPE GO



### ATTENZIONE

Evitare che i componenti del sistema GlideScope vengano a contatto con liquidi diversi da quelli raccomandati nel presente manuale. L'esposizione a liquidi può danneggiare le parti elettroniche o interne di alcuni componenti.


Se la base di ricarica viene in contatto con cute non integra o membrane mucose è necessario procedere alla pulizia. In caso contrario, pulire la base di ricarica a intervalli regolari, rispettando la programmazione stabilita dal fornitore o dalla struttura sanitaria.

**1**



Accertarsi che il monitor sia stato rimosso dalla base di ricarica, quindi scollegare l'alimentazione.

**2**



Strofinare le superfici esterne della base di ricarica con una soluzione compatibile.

Per un elenco delle soluzioni compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Per istruzioni specifiche su pulizia e uso, consultare le istruzioni del produttore della soluzione.



### ATTENZIONE

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfeccati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.



# MONITOR VIDEO GLIDESCOPE, CARRELLO PREMIUM, SUPPORTO MOBILE E ADATTATORE



Leggere la sezione [Avvertenze e precauzioni](#) prima di eseguire le operazioni descritte in questa sezione.

## IMPORTANTE

Non lasciare che eventuali agenti contaminanti si depositino a lungo sul dispositivo. Una volta incrostatati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere.

Quando si utilizzano i detergenti elencati nel presente manuale, leggere e attenersi alle istruzioni per l'uso del prodotto in tutte le applicazioni.

*Nota: nella tabella seguente si presuppone che tutti gli elementi siano utilizzati come previsto.*

*Tabella 25. Requisiti di ricondizionamento per monitor video GlideScope*

DISPOSITIVO	LIVELLI DI RICONDIZIONAMENTO RICHIESTI			
	Pulizia	Basso	Alto	Sterilizzazione
Monitor	✓			

*I livelli di ricondizionamento mostrati in questa tabella si riferiscono alle classificazioni CDC/Spaulding.*

## IMPORTANTE

Le informazioni sui prodotti di ricondizionamento materialmente compatibili ed efficaci sono disponibili nella tabella della pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts). Esaminare queste informazioni, prima di eseguire le procedure descritte in questo capitolo.



## AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di elettrocuzione, prima di pulire il monitor o la postazione di lavoro, spegnere il monitor e scollegare l'alimentazione. Scollegare la spina di alimentazione dalla sorgente di corrente CA.



## COMPONENTI TRATTATI IN QUESTA SEZIONE

Questa sezione del manuale contiene le istruzioni di ricondizionamento per i componenti seguenti:



Monitor video GlideScope



Carrello Premium per monitor video GlideScope



Supporto mobile per monitor video GlideScope



Alimentatore per monitor video GlideScope



## PROCEDURA 1. PULIZIA DEL MONITOR VIDEO GLIDESCOPE

Se il monitor video viene in contatto con cute non integra o membrane mucose è necessario procedere alla pulizia. In caso contrario, pulire la base di ricarica a intervalli regolari, rispettando la programmazione stabilita dal fornitore o dalla struttura sanitaria.

*Nota: superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del componente.*

1		Accertarsi <b>che il monitor sia stato spento</b> , quindi scollegare l'alimentazione al monitor.
2		<p><b>Strofinare le superfici esterne del monitor con una soluzione compatibile.</b></p> <p>Per un elenco delle soluzioni compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina <a href="http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts">verathon.com/glidescope_reprocessingproducts</a>.</p> <p>Per istruzioni specifiche su pulizia e uso, consultare le istruzioni del produttore della soluzione.</p>



## PROCEDURA 2. PULIZIA DELL'ADATTATORE DEL MONITOR VIDEO GLIDESCOPE




### AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche. Non immergere in acqua l'adattatore. Piuttosto, utilizzare un panno inumidito di alcool isopropilico per pulire le parti esterne dell'adattatore.


Pulire l'adattatore secondo necessità o rispettando la programmazione stabilita dal fornitore o dalla struttura sanitaria.

1



Accertarsi che **il sistema sia stato spento**, quindi scollegare l'adattatore dal monitor e dalla presa di corrente.

2





Strofinare le superfici esterne dell'adattatore con un panno inumidito con alcool isopropilico.

Non immergere in acqua l'adattatore.



### PROCEDURA 3. PULIZIA DEL CARRELLO PREMIUM O DEL SUPPORTO MOBILE PER IL MONITOR VIDEO GLIDESCOPE

1		<p>Accertarsi che il monitor sia stato spento, quindi scollegare il suo adattatore.</p>
2		<p>Strofinare le superfici esterne del carrello o supporto con una soluzione compatibile. Per un elenco delle soluzioni compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina <a href="http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts">verathon.com/glidescope_reprocessingproducts</a>. Per istruzioni specifiche su pulizia e uso, consultare le istruzioni del produttore della soluzione.</p>

# MANDRINI RIUTILIZZABILI GLIDERITE



Leggere la sezione **Avvertenze e precauzioni** prima di eseguire le operazioni descritte in questa sezione.

Poiché il mandrino rigido GlideRite e il mandrino DLT GlideRite sono dispositivi riutilizzabili, è necessario eseguire la pulizia e la disinfezione o sterilizzazione di alto livello prima dell'uso e tra un uso e l'altro. Il presente capitolo riporta le istruzioni per effettuare quanto segue:

- **Pulizia del mandrino riutilizzabile GlideRite**—Pulire il mandrino e prepararlo per la disinfezione di alto livello o per la sterilizzazione.
- **Disinfezione del mandrino riutilizzabile GlideRite**—Disinfettare con procedura di alto livello il mandrino.
- **Sterilizzazione del mandrino riutilizzabile GlideRite (facoltativa)**—Sterilizzare il mandrino.

Per preparare il mandrino per l'uso sul paziente successivo, completare la prima procedura, poi la seconda o la terza. Una disinfezione o sterilizzazione corretta è fondamentale.

## IMPORTANTE

Non lasciare che eventuali agenti contaminanti si depositino a lungo sul dispositivo. Una volta incrostati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere.

Quando si utilizzano i disinfettanti elencati nel presente manuale, leggere e attenersi alle istruzioni per l'uso del prodotto in tutte le applicazioni.

*Nota: si presuppone che tutti i componenti elencati nella tabella seguente siano utilizzati come previsto.*

Tabella 26. Requisiti di ricondizionamento per mandrini riutilizzabili GlideRite

DISPOSITIVO	LIVELLI DI RICONDIZIONAMENTO RICHIESTI			
	Pulizia	Basso	Alto	Sterilizzazione
Mandrino rigido GlideRite			✓	
Mandrino DLT GlideRite			✓	

I livelli di ricondizionamento mostrati in questa tabella si riferiscono alle classificazioni CDC/Spaulding.

## IMPORTANTE

Le informazioni sui prodotti di ricondizionamento materialmente compatibili ed efficaci sono disponibili nella tabella della pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts). Esaminare queste informazioni, prima di eseguire le procedure descritte in questo capitolo.

## COMPONENTI TRATTATI IN QUESTA SEZIONE

Questa sezione del manuale contiene le istruzioni di ricondizionamento per i componenti seguenti:



## PROCEDURA 1. PULIZIA DEL MANDRINO RIUTILIZZABILE GLIDERITE



### ATTENZIONE


I componenti riutilizzabili dei sistemi GlideScope non sono spediti in condizioni sterili. Prima del primo utilizzo, è dunque necessario pulirli e disinfezionarli o sterilizzarli, se opportuno. In caso contrario, aumenta il rischio di infezione.

### PRIMA DI INIZIARE

Prima di eseguire la pulizia, evitare che qualsiasi agente contaminante si asciughi sulle superfici del componente. Una volta incrostati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere.

### PULIZIA DEL MANDRINO RIUTILIZZABILE GLIDERITE (CON UN PRODOTTO LIQUIDO)


1



Sciacquare il componente in acqua del rubinetto pulita.

Per i requisiti di temperatura dell'acqua, fare riferimento alla [Tabella 27 a pagina 97](#).


2



Preparare la soluzione detergente.

Per la concentrazione, la temperatura e altre istruzioni per la preparazione, consultare [Tabella 27 a pagina 97](#).


3



Lavare il componente nella soluzione detergente.

Per il tempo di esposizione, la temperatura e altre istruzioni per il lavaggio, consultare [Tabella 27 a pagina 97](#).

**4**



Sciacquare il componente per rimuovere la soluzione detergente.

Per il tempo di risciacquo, la temperatura e altre istruzioni per il risciacquo, consultare [Tabella 27](#) a pagina 97.


**5**



Esaminare il componente per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa.

Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 3.

**6**




Asciugare il componente.

Utilizzare aria pulita di tipo ospedaliero per soffiare via l'umidità residua dai connettori, quindi asciugare il componente con uno dei metodi seguenti:

- aria pulita di tipo ospedaliero
- un panno pulito che non lascia pelucchi

**7**




Esaminare il componente per accertarsi che non sia danneggiato.

Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura.

Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.

**8**



Disinfettare o sterilizzare il componente.

Per la disinfezione, procedere con [Disinfezione del mandrino riutilizzabile GlideRite](#) a pagina 102.

La sterilizzazione è facoltativa. Per la sterilizzazione, procedere con [Sterilizzazione del mandrino riutilizzabile GlideRite \(facoltativa\)](#) a pagina 108.



#### ATTENZIONE

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfettati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.

## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (PRODOTTI LIQUIDI)

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 27. Soluzioni detergenti per mandrini riutilizzabili GlideRite

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Schiuma detergente Ecolab OptiPro Multi - Enzymatic Low	Pulizia	3.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente con una concentrazione pari a 3,9–15,6 ml/l (0,5–2 once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per 2–5 minuti. Successivamente, spazzolare tutte le superfici del componente tranne la finestra della videocamera con una spazzola a setole morbide, per rimuovere qualsiasi traccia visibile di agente contaminante.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua fredda corrente per 3 minuti e spazzolarne tutte le superfici con una spazzola a setole morbide.</p> <p><b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Metrex CaviCide	Pulizia	1.500	<p><b>Esposizione:</b> utilizzando la soluzione detergente a una temperatura di 33–40 °C (91–104 °F) e alla massima concentrazione, spruzzarla su tutte le superfici, in modo da bagnarle bene. Lasciare agire la soluzione sul componente per 3 minuti. Spazzolare tutte le superfici del componente.</p> <p><i>Nota: spruzzare la soluzione sul componente tutte le volte necessarie, per essere certi che tutte le superfici rimangano bagnate per tutti i 3 minuti.</i></p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente per 5 minuti. Durante questa fase, utilizzare una spazzola a setole morbide e una siringa per arrivare anche nelle zone più difficili da raggiungere.</p> <p><b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>



Tabella 27. Soluzioni detergenti per mandrini riutilizzabili GlideRite

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Getinge Tec Wash III	Pulizia	1.500	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20–40 °C (68–104 °F) per 3 minuti, spazzolandone tutte le superfici.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente per 3 minuti.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Metrex EmPower	Pulizia	1.500	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente a una temperatura di 19–29 °C (66–84 °F) e in una concentrazione di 8 ml/l (1 oncia di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per 3 minuti. Prima di rimuovere il componente dalla soluzione, spazzolarne tutte le superfici. Prestare particolare attenzione alle zone difficili da raggiungere.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente per 3 minuti.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Pro-Line Solutions EcoZyme	Pulizia	1.500	<p><b>Esposizione:</b> preparare 8 ml/l (1 oncia di liquido per gallone, sistema americano) di soluzione detergente in acqua a 30-40 °C (86–104 °F). Immergere il componente per 5 minuti. Prima di rimuovere il componente dalla soluzione, spazzolarne tutte le superfici. Prestare particolare attenzione alle zone difficili da raggiungere.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente a una temperatura di 19–29 °C (66–84 °F) per 5 minuti.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>








Tabella 27. Soluzioni detergenti per mandrini riutilizzabili GlideRite

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
STERIS Prolystica 2X Prodotto enzimatico concentrato per la pulizia e la pre-immersione <sup>†</sup>	Pulizia	3.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente a una temperatura di <math>35^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}</math> e in una concentrazione di 1–4 ml/l (0,125–0,5 once di liquido per gallone, sistema americano). Immagazzinare il componente per almeno 3 minuti. Prima di rimuovere il componente dalla soluzione, spazzolarne tutte le superfici, prestando particolare attenzione alle zone più difficili da raggiungere.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente tiepida per 3 minuti. Se il componente rimane immerso per più di 3 minuti, aumentare il tempo di risciacquo in proporzione.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.

† Dopo aver utilizzato STERIS Prolystica 2X Concentrate per pulire un componente che viene a contatto diretto con il paziente, è necessario disinfezionare o sterilizzare quest'ultimo come descritto nel presente manuale. Il passaggio di disinfezione o sterilizzazione neutralizza eventuali enzimi rimanenti e previene la citotossicità.

## PULIZIA DEL MANDRINO RIUTILIZZABILE GLIDERITE (CON SALVIETTE)

1		<p><b>Pulire il componente strofinandolo con le salviette.</b> Strofinare nuovamente il componente con le salviette ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare tutte le salviette necessarie. Per istruzioni specifiche, consultare <a href="#">Tabella 28 a pagina 101</a>. (Queste informazioni variano a seconda delle salviette utilizzate.)</p>
2		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa. Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 1.</p>
3		<p><b>Asciugare il componente.</b> Lasciarlo asciugare bene all'aria.</p>
4		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che non sia danneggiato. Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura. Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.</p>
5		<p><b>Disinfettare o sterilizzare il componente.</b> Per la disinfezione, procedere con <a href="#">Disinfezione del mandrino riutilizzabile GlideRite a pagina 102</a>. La sterilizzazione è facoltativa. Per la sterilizzazione, procedere con <a href="#">Sterilizzazione del mandrino riutilizzabile GlideRite (facoltativa) a pagina 108</a>.</p>



### ATTENZIONE

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfettati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.

## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (SALVIETTE)

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 28. Salviette detergenti per mandrini riutilizzabili GlideRite

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviette germicide usa e getta PDI Sani Cloth Bleach	Pulizia	3.000	<p><b>Esposizione:</b> con una salvietta nuova, rimuovere tutto lo sporco ostinato dal componente, quindi con una seconda salvietta inumidire bene tutte le superfici del componente. Usare tutte le salviette necessarie per essere certi che tutte le superfici rimangano visibilmente bagnate per almeno 4 minuti.</p> <p><b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare il prodotto all'aria.</p> <p><b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



## PROCEDURA 2. DISINFEZIONE DEL MANDRINO RIUTILIZZABILE GLIDERITE



### AVVERTENZA





Accertarsi che ogni componente sia completamente pulito, prima di disinfeccarlo o sterilizzarlo. Se non lo è, la procedura di disinfezione o sterilizzazione potrebbe non rimuovere tutti gli agenti contaminanti, con conseguente aumento del rischio di infezione.

Il mandrino rigido GlideRite e il mandrino DLT richiedono una disinfezione di alto livello prima dell'utilizzo. Si può scegliere di sterilizzare i mandrini, a seconda dei protocolli locali o delle preferenze della struttura. Per ulteriori informazioni sui requisiti di ricondizionamento per i mandrini, fare riferimento a [Tabella 26 a pagina 93](#).


## PRIMA DI INIZIARE

Prima della disinfezione, pulire il componente secondo le istruzioni e gli standard descritti nella sezione precedente, [Pulizia del mandrino riutilizzabile GlideRite](#).

## DISINFEZIONE DEL MANDRINO RIUTILIZZABILE GLIDERITE

1		<p><b>Preparare la soluzione disinfettante.</b> Per la concentrazione, la temperatura e altre istruzioni per la preparazione, consultare <a href="#">Tabella 29 a pagina 105</a>.</p>
2		<p><b>Esporre il componente</b> alla soluzione disinfettante. Per il tempo di esposizione, la temperatura e altre istruzioni specifiche, consultare <a href="#">Tabella 29 a pagina 105</a>. (Queste informazioni variano a seconda della soluzione utilizzata.)</p>
3		<p><b>Sciacquare il componente</b> per rimuovere la soluzione disinfettante. Per il tempo di risciacquo, la temperatura e altre istruzioni per il risciacquo, consultare <a href="#">Tabella 29 a pagina 105</a>. (Queste informazioni variano a seconda della soluzione utilizzata.)</p>
4		<p><b>Asciugare il componente.</b> Utilizzare aria pulita di tipo ospedaliero per soffiare via l'umidità residua dai connettori, quindi asciugare il componente con uno dei metodi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aria pulita di tipo ospedaliero</li><li>• un panno pulito che non lascia pelucchi</li></ul>

**5**




**Esaminare il componente** per accertarsi che non sia danneggiato.

Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura.

Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.

**6**



**Conservare il componente** in un ambiente pulito.

## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Nella tabella seguente, con il termine *acqua distillata* si intende il tipo di acqua idoneo alla disinfezione, in conformità alle normative locali e al regolamento della struttura sanitaria in cui si opera.

Tabella 29. Soluzioni disinfettanti per mandrini riutilizzabili GlideRite

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Disinfettante OPA ASP CIDEX	Alto	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 12 minuti, accertandosi che sulla sua superficie non rimangano bollicine d'aria. Utilizzare la soluzione alla massima concentrazione.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione.</p> <p style="color: #0070C0;"><b>◆ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Anios OPASTER'ANIOS/ Farmec OPASTER	Alto	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente per 30 minuti a temperatura ambiente, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria. Utilizzare la soluzione alla massima concentrazione.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione. Accertarsi di sciacquare accuratamente tutti i connettori esposti.</p> <p style="color: #0070C0;"><b>◆ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>



Tabella 29. Soluzioni disinfettanti per mandrini riutilizzabili GlideRite

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Metrex MetriCide OPA Plus	Alto	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 12 minuti, accertandosi che sulla sua superficie non rimangano bollicine d'aria. Utilizzare la soluzione alla massima concentrazione.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione.</p> <p style="color: #0070C0;"><b>► Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Cantel (MEDIVATORS) Rapicide PA 30 °C	Alto	100	<p><b>Concentrazione:</b> 750-950 parti per milione</p> <p><b>Esposizione:</b> condizionare il componente per 5 minuti in un sistema Cantel Advantage Plus o DSD Edge AER con la configurazione seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Collegamento: 2-8-002HAN Rev. B</li><li>• Parametro: 1-24-010 C DISF</li></ul> <p style="color: #0070C0;"><b>► Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Metrex MetriCide 28	Alto	1.500	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente per 20 minuti a 25 °C (77 °F), accertandosi che sulla sua superficie non rimangano bollicine d'aria.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente in acqua distillata a 33–40 °C (91–104 °F). Immergerlo 3 volte, per 3 minuti ogni volta. Agitarlo e spazzolarlo con una spazzola con setole morbide durante ogni immersione.</p> <p style="color: #0070C0;"><b>► Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
STERIS Resert XL HLD <sup>†</sup> Revital-Ox Resert XL HLD <sup>†</sup> Revital-Ox Resert HLD/ Chemosterilant <sup>‡</sup>	Alto	1.500	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 8 minuti, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente una volta per 1 minuto in acqua distillata, mantenendolo in agitazione. Verificare che il connettore sia stato risciacquato correttamente.</p> <p style="color: #0070C0;"><b>► Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>



Tabella 29. Soluzioni disinfettanti per mandrini riutilizzabili GlideRite

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
STERIS S40 o S20	Alto	500	<p>Utilizzare i cicli standard nei seguenti processori: SYSTEM 1E (negli Stati Uniti) STERIS SYSTEM 1 (fuori dagli Stati Uniti) SYSTEM 1 EXPRESS (fuori dagli Stati Uniti) SYSTEM 1 PLUS (fuori dagli Stati Uniti)</p> <p>➡ <b>Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Sistemi di lavaggio-disinfezione (disinfezione termica; solo UE)	Alto	100	<p><b>Ciclo di pulizia:</b> usare un detergente compatibile elencato in Tabella 28.</p> <p><b>Ciclo di disinfezione:</b> esporre il componente per almeno 5 minuti a 90 °C (194 °F), o per almeno 2,5 minuti a 93 °C (199 °F).</p> <p><b>Ciclo di asciugatura:</b> asciugare il componente a una temperatura non superiore a 95 °C (203 °F), poi lasciarlo raffreddare.</p> <p>➡ <b>Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.

† Questo prodotto chimico può causare lo scolorimento del metallo. Tuttavia, tale effetto non influisce sulla funzionalità o l'efficacia.

## PROCEDURA 3. STERILIZZAZIONE DEL MANDRINO RIUTILIZZABILE GLIDERITE (FACOLTATIVA)



### AVVERTENZA





Accertarsi che ogni componente sia completamente pulito, prima di disinfeccarlo o sterilizzarlo. Se non lo è, la procedura di disinfezione o sterilizzazione potrebbe non rimuovere tutti gli agenti contaminanti, con conseguente aumento del rischio di infezione.

La sterilizzazione del mandrino rigido GlideRite o del mandrino DLT è facoltativa. Tuttavia, è possibile che la struttura sanitaria o il fornitore richiedano la sterilizzazione dei componenti in questione prima dell'utilizzo. Per sterilizzare il mandrino rigido GlideRite o il mandrino DLT, attenersi alla procedura seguente.

### PRIMA DI INIZIARE

Prima della sterilizzazione, pulire il componente secondo le istruzioni e gli standard descritti nella sezione precedente, [Pulizia del mandrino riutilizzabile GlideRite](#).

## STERILIZZAZIONE DEL MANDRINO RIUTILIZZABILE GLIDERITE

1		<p><b>Confezionare il componente</b> in una busta, materiale avvolgente o altro contenitore, se opportuno.</p> <p>Per il tipo di confezionamento opportuno per il sistema di sterilizzazione in uso, fare riferimento alle istruzioni del produttore e alla <a href="#">Tabella 30 a pagina 110</a>.</p>
2		<p><b>Sterilizzare il componente.</b></p> <p>Per le impostazioni del ciclo compatibile e altre informazioni specifiche, fare riferimento alla <a href="#">Tabella 30 a pagina 110</a>. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni del produttore del sistema di sterilizzazione.</p>
3		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che non sia danneggiato.</p> <p>Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura.</p> <p>Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.</p>
4		<p><b>Conservare il componente</b> in un ambiente idoneo per apparecchiature sterili.</p>

## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Nella tabella seguente sono fornite istruzioni specifiche ritenute efficaci su questi componenti. Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 30. Sterilizzazione dei prodotti per mandrini riutilizzabili GlideRite

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	CICLI*	CONDIZIONI
Sterilizzatore al perossido di idrogeno Gas Plasma ASP	Sterilizzazione	500	Inserire il componente in una busta Tyvek, quindi sterilizzarlo utilizzando uno dei seguenti processori: STERRAD 100S (per gli Stati Uniti) STERRAD 100S ciclo corto (fuori dagli Stati Uniti) STERRAD NX ciclo standard STERRAD 100NX ciclo standard STERRAD 50 STERRAD 200 ciclo corto  <b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
Sistemi STERIS V-PRO con Vaprox HC	Sterilizzazione	500	Inserire il componente in una busta Tyvek, quindi attivare il ciclo non-lumen in uno dei sistemi di sterilizzazione a bassa temperatura STERIS Amsco V-PRO.  <b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
Autoclave (ciclo a vapore)	Sterilizzazione	300	<b>Minimo:</b> sterilizzare il componente per 3 minuti a 134 °C (273 °F) o 4 minuti a 132 °C (270 °F).  <b>Massimo:</b> sterilizzare il componente per 18 minuti a 137 °C (279 °F).  <b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.

† Questo prodotto chimico può causare lo scolorimento del metallo. Tuttavia, tale effetto non influisce sulla funzionalità o l'efficacia.



## CAVI QUICKCONNECT



Leggere la sezione **Avvertenze e precauzioni** prima di eseguire le operazioni descritte in questa sezione.

### IMPORTANTE

Non lasciare che eventuali agenti contaminanti si depositino a lungo sul dispositivo. Una volta incrostatati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere.

Quando si utilizzano i disinfettanti elencati nel presente manuale, leggere e attenersi alle istruzioni per l'uso del prodotto in tutte le applicazioni.

*Nota: si presuppone che tutti i componenti elencati nella tabella seguente siano utilizzati come previsto.*

Tabella 31. Requisiti di ricondizionamento per cavi QuickConnect

DISPOSITIVO	LIVELLI DI RICONDIZIONAMENTO RICHIESTI			
	Pulizia	Basso	Alto	Sterilizzazione
Cavo QuickConnect per monitor video GlideScope	✓			
Cavo QuickConnect per GlideScope Core	✓			


I livelli di ricondizionamento mostrati in questa tabella si riferiscono alle classificazioni CDC/Spaulding.

### IMPORTANTE

Le informazioni sui prodotti di ricondizionamento materialmente compatibili ed efficaci sono disponibili nella tabella della pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts). Esaminare queste informazioni, prima di eseguire le procedure descritte in questo capitolo.

## COMPONENTI TRATTATI IN QUESTA SEZIONE

Questa sezione del manuale contiene le istruzioni di ricondizionamento per i componenti seguenti:



Cavo QuickConnect per GlideScope Core



Cavo QuickConnect per monitor video GlideScope

*Nota: queste immagini sono state ridotte a scopo illustrativo.*

## PROCEDURA 1. PREPARAZIONE DI UN CAVO QUICKCONNECT PER LA PULIZIA

1



Accertarsi che il monitor sia stato spento.

2



Scollegare il cavo video.


- Monitor video GlideScope: ruotare l'anello connettore nella direzione indicata dalla freccia, quindi tirare.
- Monitor Core: tenere il connettore in una mano e sostenere il monitor con l'altra, quindi tirare.

3




Scollegare il laringoscopio.

Tenere il connettore in una mano, il laringoscopio nell'altra e tirare.



**4**




**Applicare un pre-detergente (facoltativo).**

Una volta incrostatati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere.

Per informazioni sui pre-detergenti compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

**5**



**Pulire il componente.**

Continuare con **Pulizia di un cavo QuickConnect** a pagina 114.

## PROCEDURA 2. PULIZIA DI UN CAVO QUICKCONNECT




Leggere la sezione [Avvertenze e precauzioni](#) prima di eseguire la seguente operazione.

### PULIZIA DI UN CAVO QUICKCONNECT (CON UN PRODOTTO LIQUIDO)

!		<p>Prima di pulirlo, il componente deve essere preparato. Per le istruzioni, consultare <a href="#">Preparazione di un cavo QuickConnect per la pulizia</a> a pagina 112.</p>
1		<p>Sciacquare il componente in acqua del rubinetto pulita. Strofinare il componente con una spazzola a setole morbide fino a quando vengono rimossi tutti i segni di contaminazione visibili. Ispezionare tutti i connettori per rilevare la presenza di eventuali agenti contaminanti. Se si notano tracce di agenti contaminanti, rimuoverle utilizzando uno spazzolino lungo a setole morbide o un cotton fioc.</p>
2		<p>Preparare la soluzione detergente. Per la concentrazione, la temperatura e altre istruzioni per la preparazione, consultare <a href="#">Tabella 32</a> a pagina 117.</p>
3		<p>Lavare il componente nella soluzione detergente. Per il tempo di esposizione, la temperatura e altre istruzioni per il lavaggio, consultare <a href="#">Tabella 32</a> a pagina 117. (Queste informazioni variano a seconda della soluzione detergente utilizzata.)</p>




4



**Sciacquare il componente** per rimuovere la soluzione detergente.

Per il tempo di risciacquo, la temperatura e altre istruzioni per il risciacquo, consultare [Tabella 32 a pagina 117](#). (Queste informazioni variano a seconda della soluzione detergente utilizzata.)


5



**Esaminare il componente** per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa.

Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 3.


6



**Asciugare il componente.**

Utilizzare aria pulita di tipo ospedaliero per soffiare via l'umidità residua dai connettori, quindi asciugare il componente con tale aria pulita.

7




**Esaminare il componente** per accertarsi che non sia danneggiato.

Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura.

Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.

*Nota: maneggiare il componente con cura onde evitare la ricontaminazione.*

8



**Disinfettare il componente** (facoltativo).

Per la disinfezione, procedere con [Disinfezione di un cavo QuickConnect Cable \(facoltativa\)](#) a pagina 122.

Altrimenti, conservare il dispositivo in un ambiente pulito.



#### ATTENZIONE

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfettati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.

## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (PRODOTTI LIQUIDI)

Verathon ha convalidato la compatibilità chimica e l'efficacia biologica dei prodotti specificati in questa tabella per la pulizia dei componenti indicati secondo le istruzioni elencate nella colonna Condizioni.

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).







Tabella 32. Soluzioni detergenti per cavi GlideScope QuickConnect

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Detergente enzimatico ASP CIDEZYME (ENZOL)	Pulizia	Cavo QuickConnect per monitor video GlideScope	1.500	<b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente in acqua tiepida a una concentrazione di 8–16 ml/l (1–2 once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente con i suoi connettori e lasciarlo immerso per 1–3 minuti. Pulire il componente immerso con una spazzola con setole morbide.
		Cavo QuickConnect per GlideScope Core		Quando si pulisce il cavo QuickConnect per il monitor video GlideScope, prestare particolare attenzione a incrinature, fessure, giunture e zone difficili da raggiungere. <b>Sciacquare</b> il componente per 3 minuti in acqua corrente del rubinetto, accertandosi che siano sciacquati correttamente anche i connettori. <b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>


\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.

## PULIZIA DI UN CAVO QUICKCONNECT (CON SALVIETTE)

!		<p>Prima di pulirlo, il componente deve essere preparato. Per le istruzioni, consultare <a href="#">Preparazione di un cavo QuickConnect per la pulizia</a> a pagina 112.</p>
1		<p><b>Pulire il componente strofinandolo con le salviette.</b> Strofinare nuovamente il componente con le salviette ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare tutte le salviette necessarie. Per istruzioni specifiche, consultare <a href="#">Tabella 33</a> a pagina 121. (Queste informazioni variano a seconda delle salviette utilizzate.)</p>
2		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa. Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 1.</p>
3		<p><b>Asciugare il componente.</b> Lasciarlo asciugare bene all'aria.</p>
4		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che non sia danneggiato. Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura. Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.</p>



5



Disinfettare il componente (facoltativo).

Per la disinfezione, procedere con [Disinfezione di un cavo QuickConnect Cable \(facoltativa\)](#) a pagina 122.

Altrimenti, conservare il dispositivo in un ambiente pulito.



### ATTENZIONE

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfettati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.

## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (SALVIETTE)

Verathon ha convalidato la compatibilità chimica e l'efficacia biologica dei prodotti specificati in questa tabella per la pulizia dei componenti indicati secondo le istruzioni elencate nella colonna Condizioni.

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).



Tabella 33. Salviette detergenti per cavi GlideScope QuickConnect

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviettine germicide AF3 usa e getta PDI Sani-Cloth	Pulizia	Cavo QuickConnect per monitor video GlideScope	1.500	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Con una salvietta nuova e pulita, strofinare l'estremità del cavo che si collega al monitor (connettore nero) muovendo la salvietta avanti e indietro.</li><li>b. Continuare a strofinare avanti e indietro, spostandosi via via lungo il cavo verso l'estremità che si collega al broncoscopio (connettore blu).</li><li>c. Ad ogni punto di giuntura tra gli elementi del cavo e le parti pressofuse, strofinare con cura per rimuovere ogni accumulo di sporco.</li><li>d. Con una salvietta nuova e pulita, strofinare l'estremità del cavo che si collega broncoscopio (connettore blu) muovendo la salvietta avanti e indietro.</li><li>e. Continuare a strofinare avanti e indietro, spostandosi via via lungo il cavo verso l'estremità che si collega al monitor (connettore nero).</li><li>f. Ad ogni punto di giuntura tra gli elementi del cavo e le parti pressofuse, strofinare con cura per rimuovere ogni accumulo di sporco.</li><li>g. Se vi sono punti che sembrano asciutti, strofinarli di nuovo per mantenerli visibilmente bagnati per almeno 3 minuti.</li><li>h. Lasciare asciugare il dispositivo all'aria.</li></ul> <p><b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
		Cavo QuickConnect per GlideScope Core	1.500	<p><b>Esposizione:</b> con una salvietta nuova, rimuovere tutto lo sporco ostinato visibile, quindi con altre salviette nuove inumidire tutte le superfici del componente. Usare altre salviette nella misura necessaria per mantenere il componente visibilmente bagnato per 3 minuti.</p> <p><b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria.</p> <p><b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



## PROCEDURA 3. DISINFEZIONE DI UN CAVO QUICKCONNECT CABLE (FACOLTATIVA)



### AVVERTENZA

Accertarsi che ogni componente sia completamente pulito, prima di disinfeztarlo o sterilizzarlo. Se non lo è, la procedura di disinfezione o sterilizzazione potrebbe non rimuovere tutti gli agenti contaminanti, con conseguente aumento del rischio di infezione.



Leggere la sezione [Avvertenze e precauzioni](#) prima di eseguire la seguente operazione.

Per la disinfezione di un cavo video o di uno Smart Cable attenersi alla procedura descritta di seguito.

### PRIMA DI INIZIARE

Prima di iniziare la procedura di disinfezione del componente, assicurarsi di svolgere le seguenti azioni:


- Pulire il componente secondo le istruzioni e gli standard descritti nella sezione precedente, [Pulizia di un cavo QuickConnect](#).
- Non posizionare i cappucci protettivi sui connettori dei cavi QuickConnect. Tali componenti sono progettati per essere immersi completamente, senza l'utilizzo di cappucci protettivi, che Verathon peraltro non fornisce.

### DISINFEZIONE DI UN CAVO QUICKCONNECT (CON UN PRODOTTO LIQUIDO)

1		<p><b>Preparare la soluzione disinfettante.</b> Per la concentrazione, la temperatura e altre istruzioni per la preparazione, consultare <a href="#">Tabella 34 a pagina 125</a>.</p>
2		<p><b>Esporre il componente alla soluzione disinfettante.</b> Per il tempo di esposizione, la temperatura e altre istruzioni specifiche, consultare <a href="#">Tabella 34 a pagina 125</a>. (Queste informazioni variano a seconda del disinfettante utilizzato.)</p>




**3**



**Sciacquare il componente** per rimuovere la soluzione disinfettante.

Per il tempo di risciacquo, la temperatura e altre istruzioni per il risciacquo, consultare **Tabella 34 a pagina 125**. (Queste informazioni variano a seconda del disinfettante utilizzato.)

**4**




**Asciugare il componente.**

Utilizzare aria pulita di tipo ospedaliero per soffiare via l'umidità residua dai connettori, quindi asciugare il componente con uno dei metodi seguenti:

- aria pulita di tipo ospedaliero
- un panno pulito che non lascia pelucchi

**5**




**Esaminare il componente** per accertarsi che non sia danneggiato.

Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura.

Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.

**6**



**Conservare il componente** in un ambiente pulito.

## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (PRODOTTI LIQUIDI)

Verathon ha convalidato la compatibilità chimica e l'efficacia biologica dei prodotti nella [Tabella 34](#) per la disinfezione dei componenti indicati secondo le istruzioni elencate nella colonna Condizioni.

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

### IMPORTANTE

Quando si effettua una disinfezione ad alto livello su un cavo video o Smart Cable, si può utilizzare un sistema Cantel (MEDIVATORS) CER Optima 1 & 2 AER, DSD-201 AER o SSD-102 AER, a condizione che vengano rispettati i requisiti riportati di seguito:

- Utilizzare uno dei disinfettanti ad alto livello di disinfezione indicati nella [Tabella 34](#).
- Utilizzare un disinfettante compatibile con il sistema Cantel. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità chimica, contattare Cantel.
- Seguire le condizioni di condizionamento fornite nella [Tabella 34](#), tra cui temperatura, esposizione e concentrazione per il prodotto disinfettante che si intende utilizzare.
- Non esporre il componente a temperature superiori a 60 °C (140 °F) durante i cicli.



Nella tabella seguente, con il termine *acqua distillata* si intende il tipo di acqua idoneo alla disinfezione, in conformità alle normative locali e al regolamento della struttura sanitaria in cui si opera.


Tabella 34. Soluzioni disinfettanti per cavi QuickConnect

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Disinfettante OPA ASP CIDEX	Alto	Cavo QuickConnect Core	1.500	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 12 minuti, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria. Usare la soluzione alla concentrazione massima, dopo averla verificata con strisce CIDEX OPA.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione. Usare un lotto fresco di acqua distillata per ogni immersione.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Anios OPASTER'ANIOS/ Farmec OPASTER	Alto	Cavo QuickConnect Core	1.500	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 12 minuti, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria. Usare la soluzione alla concentrazione massima, dopo averla verificata con strisce CIDEX OPA.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione. Accertarsi che tutti i connettori esposti siano sciacquati correttamente.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.

## DISINFEZIONE DI UN CAVO QUICKCONNECT (CON SALVIETTE)


1



Pulire il componente strofinandolo con le salviette.  
Strofinare nuovamente il componente con le salviette  
ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente  
bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare  
tutte le salviette necessarie.

Per istruzioni specifiche, consultare **Tabella 35** a pagina 127.  
(Queste informazioni variano a seconda delle  
salviette utilizzate.)

2



Asciugare il componente.

Lasciarlo asciugare bene all'aria.

3




Esaminare il componente per accertarsi che non  
sia danneggiato.

Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati  
parte della normale usura.

Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il  
componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.

4



Conservare il componente in un ambiente pulito.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (SALVIETTE)

Verathon ha convalidato la compatibilità chimica e l'efficacia biologica dei prodotti nella **Tabella 35** per la disinfezione dei componenti indicati secondo le istruzioni elencate nella colonna Condizioni.

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.


### IMPORTANTE

Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 35. Salviette disinfezanti per cavi QuickConnect

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviettine germicide AF3 usa e getta PDI Sani-Cloth	Basso	Cavo QuickConnect Core	1.500	<p><b>Esposizione:</b> bagnare tutte le superfici del componente e mantenerle bagnate per 3 minuti.</p> <p><b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria.</p> <p><b>⬅ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



## CAVI VIDEO E SMART CABLES



Leggere la sezione **Avvertenze e precauzioni** prima di eseguire le operazioni descritte in questa sezione.

### IMPORTANTE

Non lasciare che eventuali agenti contaminanti si depositino a lungo sul dispositivo. Una volta incrostatati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere.

Quando si utilizzano i disinfettanti elencati nel presente manuale, leggere e attenersi alle istruzioni per l'uso del prodotto in tutte le applicazioni.

*Nota: si presuppone che tutti i componenti elencati nella tabella seguente siano utilizzati come previsto.*

Tabella 36. Requisiti di ricondizionamento per cavi video e Smart Cables

DISPOSITIVO	LIVELLI DI RICONDIZIONAMENTO RICHIESTI			
	Pulizia	Basso	Alto	Sterilizzazione
Cavo video Titanium	✓			
Cavo video GlideScope Core	✓			
Spectrum Smart Cable	✓			
Smart Cable GlideScope Core	✓			

*I livelli di ricondizionamento mostrati in questa tabella si riferiscono alle classificazioni CDC/Spaulding.*

### IMPORTANTE

Le informazioni sui prodotti di ricondizionamento materialmente compatibili ed efficaci sono disponibili nella tabella della pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts). Esaminare queste informazioni, prima di eseguire le procedure descritte in questo capitolo.



## COMPONENTI TRATTATI IN QUESTA SEZIONE

Questa sezione del manuale contiene le istruzioni di ricondizionamento per i componenti seguenti:

	SS	
Cavo video Core		
	SS	
Core Smart Cable		
	SS	
Cavo video Titanium		
	SS	
Spectrum Smart Cable		

Nota: queste immagini sono state ridotte a scopo illustrativo.



## PROCEDURA 1. PREPARAZIONE DI UN CAVO VIDEO O DI UNO SMART CABLE PER LA PULIZIA

**1**



Accertarsi che il monitor sia stato spento.


**2**



### Scollegare il cavo video.


- Monitor video GlideScope: ruotare l'anello connettore nella direzione indicata dalla freccia, quindi tirare.
- Monitor Core: tenere il connettore in una mano e sostenere il monitor con l'altra, quindi tirare.

**3**

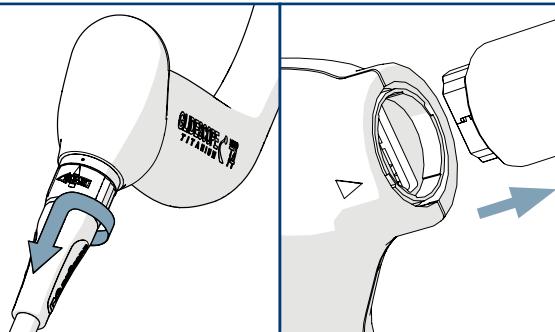


### Scollegare il laringoscopio.

- Video laringoscopi riutilizzabili: ruotare l'anello connettore nella direzione indicata dalla freccia, quindi tirare.
- Video laringoscopi monouso o videocamere: tirare con decisione il connettore per rimuoverlo dalla presa sul laringoscopio.



**4**




Applicare un pre-detergente (facoltativo).

Una volta incrostatati su una superficie, gli agenti contaminanti sono estremamente difficili da rimuovere.


Per informazioni sui pre-detergenti compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

**5**



Pulire il componente.

Continuare con [Pulizia di un cavo video o Smart Cable](#) a pagina 132.



## PROCEDURA 2. PULIZIA DI UN CAVO VIDEO O SMART CABLE



Leggere la sezione [Avvertenze e precauzioni](#) prima di eseguire la seguente operazione.


Per la pulizia di un cavo video Titanium o di uno Spectrum Smart Cable attenersi alla procedura descritta di seguito. È fondamentale rimuovere qualsiasi traccia di agenti contaminanti da un componente prima di sottoporlo a disinfezione o sterilizzazione.

### PULIZIA DI UN CAVO VIDEO O SMART CABLE (CON UN PRODOTTO LIQUIDO)

!		<p>Prima di pulirlo, il componente deve essere preparato.</p> <p>Per le istruzioni, consultare <a href="#">Preparazione di un cavo video o di uno Smart Cable per la pulizia a pagina 130</a>.</p>
1		<p>Sciacquare il componente in acqua del rubinetto pulita.</p> <p>Strofinare il componente con una spazzola a setole morbide fino a quando vengono rimossi tutti i segni di contaminazione visibili.</p> <p>Ispezionare tutti i connettori per rilevare la presenza di eventuali agenti contaminanti. Se si notano tracce di agenti contaminanti, rimuoverle utilizzando uno spazzolino lungo a setole morbide o un cotton fioc.</p>
2		<p>Preparare la soluzione detergente.</p> <p>Per la concentrazione, la temperatura e altre istruzioni per la preparazione, consultare <a href="#">Tabella 37 a pagina 134</a>.</p>
3		<p>Lavare il componente nella soluzione detergente.</p> <p>Per il tempo di esposizione, la temperatura e altre istruzioni per il lavaggio, consultare <a href="#">Tabella 37 a pagina 134</a>.</p> <p>(Queste informazioni variano a seconda della soluzione detergente utilizzata.)</p>




4



**Sciacquare il componente** per rimuovere la soluzione detergente.

Per il tempo di risciacquo, la temperatura e altre istruzioni per il risciacquo, consultare [Tabella 37 a pagina 134](#). (Queste informazioni variano a seconda della soluzione detergente utilizzata.)


5



**Esaminare il componente** per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa.

Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 3.

6




**Asciugare il componente.**

Utilizzare aria pulita di tipo ospedaliero per soffiare via l'umidità residua dai connettori, quindi asciugare il componente con uno dei metodi seguenti:

- aria pulita di tipo ospedaliero
- un panno pulito che non lascia pelucchi

7




**Esaminare il componente** per accertarsi che non sia danneggiato.

Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura.

Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.

*Nota: maneggiare il componente con cura onde evitare la ricontaminazione.*

8



**Disinfettare o sterilizzare il componente** (facoltativo).

Per la disinfezione, procedere con [Disinfezione di un cavo video o Smart Cable \(facoltativa\)](#) a pagina 143.


Per la sterilizzazione, procedere con [Sterilizzazione di un cavo video o Smart Cable \(facoltativa\)](#) a pagina 154.

Altrimenti, conservare il dispositivo in un ambiente pulito.



#### ATTENZIONE

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfettati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (PRODOTTI LIQUIDI)

Verathon ha convalidato la compatibilità chimica e l'efficacia biologica dei prodotti specificati in questa tabella per la pulizia dei componenti indicati secondo le istruzioni elencate nella colonna Condizioni.

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguente sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 37. Soluzioni detergenti per cavi video e Smart Cables

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Detergente enzimatico ASP CIDEZYME (ENZOL)	Pulizia	Cavo video Core	1.500	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente in acqua tiepida a una concentrazione di 8–16 ml/l (1-2 once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente con i suoi connettori e lasciarlo immerso per 1–3 minuti. Pulire il componente immerso con una spazzola con setole morbide.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente per 3 minuti in acqua corrente del rubinetto, accertandosi che siano sciacquati correttamente anche i connettori.</p>
		Core Smart Cable		<p>◀ <b>Tornare alla procedura descritta in precedenza</b> e completare i passaggi rimanenti.</p>
Getinge Tec Wash III	Pulizia	Cavo video Titanium	3.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente a una temperatura di 20–40 °C (68–104 °F) e in una concentrazione di 2–8 ml/l (0,25–1 once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per 3 minuti, spazzolandone tutte le superfici.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente per 3 minuti.</p> <p>◀ <b>Tornare alla procedura descritta in precedenza</b> e completare i passaggi rimanenti.</p>



Tabella 37. Soluzioni detergenti per cavi video e Smart Cables

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
STERIS Prolystica 2X Prodotto enzimatico concentrato per la pulizia e la pre-immersione	Pulizia	Cavo video Titanium	3.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente a una temperatura di <math>35\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}</math> e in una concentrazione di 1–4 ml/l (0,125–0,5 once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per almeno 3 minuti. Prima di rimuovere il componente dalla soluzione, pulirne tutte le superfici con una spazzola a setole morbide prestando particolare attenzione alle zone più difficili da raggiungere.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente tiepida per 3 minuti. Se il componente rimane immerso per più di 3 minuti, aumentare il tempo di risciacquo in proporzione.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
		Spectrum Smart Cable	1.500	
Metrex EmPower	Pulizia	Cavo video Titanium	3.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente a una temperatura di <math>19\text{--}29\text{ }^{\circ}\text{C}</math> (66–84 °F) e in una concentrazione di 7,8 ml/l (1 oncia di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per 3 minuti. Prima di rimuovere il componente dalla soluzione, spazzolarne tutte le superfici. Prestare particolare attenzione alle zone difficili da raggiungere.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente per 3 minuti.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
		Spectrum Smart Cable	1.500	
Schiuma detergente Ecolab OptiPro Multi - Enzymatic Low	Pulizia	Cavo video Titanium	3.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare la soluzione detergente con una concentrazione pari a 3,9–15,6 ml/l (0,5–2 once di liquido per gallone, sistema americano). Immergere il componente per 2–5 minuti. Successivamente, spazzolare tutte le superfici del componente con una spazzola a setole morbide, per rimuovere qualsiasi traccia visibile di agente contaminante.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua fredda corrente per 3 minuti e spazzolarne tutte le superfici con una spazzola a setole morbide.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
		Spectrum Smart Cable	1.500	




Tabella 37. Soluzioni detergenti per cavi video e Smart Cables


PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Metrex CaviCide	Pulizia	Cavo video Titanium	3.000	<p><b>Esposizione:</b> utilizzando la soluzione detergente a una temperatura di 33–40 °C (91–104 °F) e alla massima concentrazione, spruzzarla su tutte le superfici, in modo da bagnarle bene. Lasciare bagnato il componente per 5 minuti, spazzolandone tutte le superfici. Sciacquare il componente sotto acqua corrente per 3 minuti, quindi spruzzare di nuovo la soluzione detergente su tutte le sue superfici in modo da bagnarle bene. Lasciare agire la soluzione sul componente per 10 minuti.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente per 5 minuti, quindi immergerlo completamente in acqua e agitarlo per 2 minuti. Mentre è ancora immerso, spazzolarlo con una spazzola con setole morbide. Rimuovere il componente dall'acqua, quindi sciacquare i suoi connettori con una siringa e acqua corrente. Immergere il componente completamente in acqua <b>fresca</b> e agitare per 2 minuti. Sciacquare il componente sotto acqua corrente per 1 minuto.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>



Tabella 37. Soluzioni detergenti per cavi video e Smart Cables

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Metrex CaviCide (segue)	Pulizia	Spectrum Smart Cable	1.500	<p><b>Esposizione:</b> utilizzando la soluzione detergente a una temperatura di 33–40 °C (91–104 °F) e alla massima concentrazione, spruzzarla su tutte le superfici, in modo da bagnarle bene. Lasciare bagnato il componente per 10 minuti, spazzolandone tutte le superfici. Sciacquare il componente sotto acqua corrente per 5 minuti, quindi spruzzare di nuovo la soluzione detergente su tutte le sue superfici in modo da bagnarle bene. Lasciare agire la soluzione sul componente per 10 minuti.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente per 5 minuti, quindi immergerlo completamente in acqua e agitarlo per 3 minuti. Mentre è ancora immerso, spazzolarlo con una spazzola con setole morbide. Rimuovere il componente dall'acqua, quindi sciacquare i suoi connettori con una siringa e acqua corrente. Immergere il componente completamente in acqua <b>fresca</b> e agitare per 3 minuti. Sciacquare il componente sotto acqua corrente per 2 minuti.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Pro-Line Solutions EcoZyme	Pulizia	Cavo video Titanium	3.000	<p><b>Esposizione:</b> preparare 7,8 ml/l (1 oncia di liquido per gallone, sistema americano) di soluzione detergente in acqua a 30–40 °C (86–104 °F). Immergere il componente per 5 minuti. Prima di rimuoverlo dalla soluzione, spazzolarne tutte le superfici. Prestare particolare attenzione alle zone difficili da raggiungere. Sciacquare i connettori del componente utilizzando una siringa.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente sotto acqua corrente a una temperatura di 19–29 °C (66–84 °F) per 5 minuti. Sciacquare i suoi connettori utilizzando una siringa.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
		Spectrum Smart Cable	1.500	

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.




## PULIZIA DI UN CAVO VIDEO O SMART CABLE (CON SALVIETTE)

!		<p>Prima di pulirlo, il componente deve essere preparato. Per le istruzioni, consultare <a href="#">Preparazione di un cavo video o di uno Smart Cable per la pulizia</a> a pagina 130.</p>
1		<p><b>Pulire il componente strofinandolo con le salviette.</b> Strofinare nuovamente il componente con le salviette ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare tutte le salviette necessarie. Per istruzioni specifiche, consultare <a href="#">Tabella 38 a pagina 140</a>. (Queste informazioni variano a seconda delle salviette utilizzate.)</p>
2		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che ogni traccia di agente contaminante sia stata rimossa. Se rimangono tracce visibili di agenti contaminanti, tornare a Fase 1.</p>
3		<p><b>Asciugare il componente.</b> Lasciarlo asciugare bene all'aria.</p>
4		<p><b>Esaminare il componente</b> per accertarsi che non sia danneggiato. Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura. Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.</p>



5



Disinfettare o sterilizzare il componente (facoltativo).

Per la disinfezione, procedere con [Disinfezione di un cavo video o Smart Cable \(facoltativa\)](#) a pagina 143.


Per la sterilizzazione, procedere con [Sterilizzazione di un cavo video o Smart Cable \(facoltativa\)](#) a pagina 154.

Altrimenti, conservare il dispositivo in un ambiente pulito.



### ATTENZIONE

Non riportare i componenti del sistema GlideScope nei luoghi di conservazione finché non sono completamente puliti e disinfettati o sterilizzati, come opportuno, al fine di evitare l'aumento del rischio di infezione.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (SALVIETTE)

Verathon ha convalidato la compatibilità chimica e l'efficacia biologica dei prodotti specificati in questa tabella per la pulizia dei componenti indicati secondo le istruzioni elencate nella colonna Condizioni.

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 38. Salviette detergenti per cavi video e Smart Cables

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Sistema di salviette Tristel Trio	Pulizia	Cavo video Titanium	3.000	<b>Esposizione:</b> utilizzare 2 o più salviette di pre-pulizia per rimuovere ogni traccia visibile di contaminazione dal componente. <b>Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
		Spectrum Smart Cable	1.500	
Metrex CaviWipes	Pulizia	Cavo video Titanium	3.000	<b>Esposizione:</b> rimuovere tutti i segni visibili di contaminazione dal componente. Bagnare tutte le superfici del componente con salviette nuove e mantenerle bagnate per 3 minuti. <b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria. <b>Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
		Spectrum Smart Cable	1.500	
Metrex CaviWipes1	Pulizia	Cavo video Titanium	3.000	<b>Esposizione:</b> utilizzare 3 o più salviette per rimuovere tutti i segni visibili di contaminazione dal componente. <b>Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
		Spectrum Smart Cable	1.500	



Tabella 38. Salviette detergenti per cavi video e Smart Cables

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviette germicide usa e getta PDI Sani-Cloth Bleach	Pulizia	Cavo video Titanium	1.500	<p><b>Esposizione:</b> con una salvietta nuova, rimuovere tutto lo sporco ostinato, quindi con una nuova salvietta inumidire bene tutte le superfici del componente. Mantenere tutte le superfici del componente visibilmente bagnate per almeno 4 minuti, utilizzando altre salviette nella misura necessaria.</p> <p><b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
		Spectrum Smart Cable		
WIP'ANIOS PREMIUM	Pulizia	Cavo video Titanium	3.000	<p><b>Esposizione:</b> con una salvietta nuova, rimuovere tutte le tracce visibili di agenti contaminanti dal componente, quindi con altre salviette nuove inumidire tutte le superficie del componente. Usare altre salviette nella misura necessaria per mantenere il componente visibilmente bagnato per 5 minuti.</p> <p><b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
		Spectrum Smart Cable	1.500	
Salviette universali Clinell	Pulizia	Cavo video Titanium	3.000	<p><b>Esposizione:</b> con una salvietta nuova, rimuovere tutte le tracce visibili di agenti contaminanti dal componente, quindi con altre salviette nuove inumidire tutte le superficie del componente. Usare altre salviette nella misura necessaria per mantenere il componente visibilmente bagnato per 5 minuti.</p> <p><b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
		Spectrum Smart Cable	1.500	




Tabella 38. Salviette detergenti per cavi video e Smart Cables

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviette PDI Sani-Cloth Active	Pulizia	Cavo video Titanium	3.000	<b>Esposizione:</b> con una salvietta nuova, rimuovere tutte le tracce visibili di agenti contaminanti dal componente, quindi con altre salviette nuove inumidire tutte le superfici del componente. Usare altre salviette nella misura necessaria per mantenere il componente visibilmente bagnato per 5 minuti. <b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria.
		Spectrum Smart Cable	1.500	<b>← Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
Salviettine germicide AF3 usa e getta PDI Sani-Cloth	Pulizia	Cavo video Titanium	3.000	<b>Esposizione:</b> con una salvietta nuova, rimuovere tutto lo sporco ostinato visibile, quindi con altre salviette nuove inumidire tutte le superficie del componente. Usare altre salviette nella misura necessaria per mantenere il componente visibilmente bagnato per 3 minuti. <b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria.
		Cavo video Core	1.500	<b>← Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
		Spectrum Smart Cable	1.500	
		Core Smart Cable	1.500	

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



### PROCEDURA 3. DISINFEZIONE DI UN CAVO VIDEO O SMART CABLE (FACOLTATIVA)




#### AVVERTENZA

Accertarsi che ogni componente sia completamente pulito, prima di disinfeztarlo o sterilizzarlo. Se non lo è, la procedura di disinfezione o sterilizzazione potrebbe non rimuovere tutti gli agenti contaminanti, con conseguente aumento del rischio di infezione.



Leggere la sezione [Avvertenze e precauzioni](#) prima di eseguire la seguente operazione.

Per la disinfezione di un cavo video o di uno Smart Cable attenersi alla procedura descritta di seguito.




## PRIMA DI INIZIARE

Prima di iniziare la procedura di disinfezione del componente, assicurarsi di svolgere le seguenti azioni:


- Pulire il componente secondo le istruzioni e gli standard descritti nella sezione precedente, [Pulizia di un cavo video o Smart Cable](#).
- Non cercare di applicare un cappuccio protettivo sui connettori dei cavi video o Smart Cables. Tali componenti sono progettati per essere immersi completamente, senza l'utilizzo di cappucci protettivi, che Verathon peraltro non fornisce.

## DISINFEZIONE DI UN CAVO VIDEO O SMART CABLE (CON UN PRODOTTO LIQUIDO)

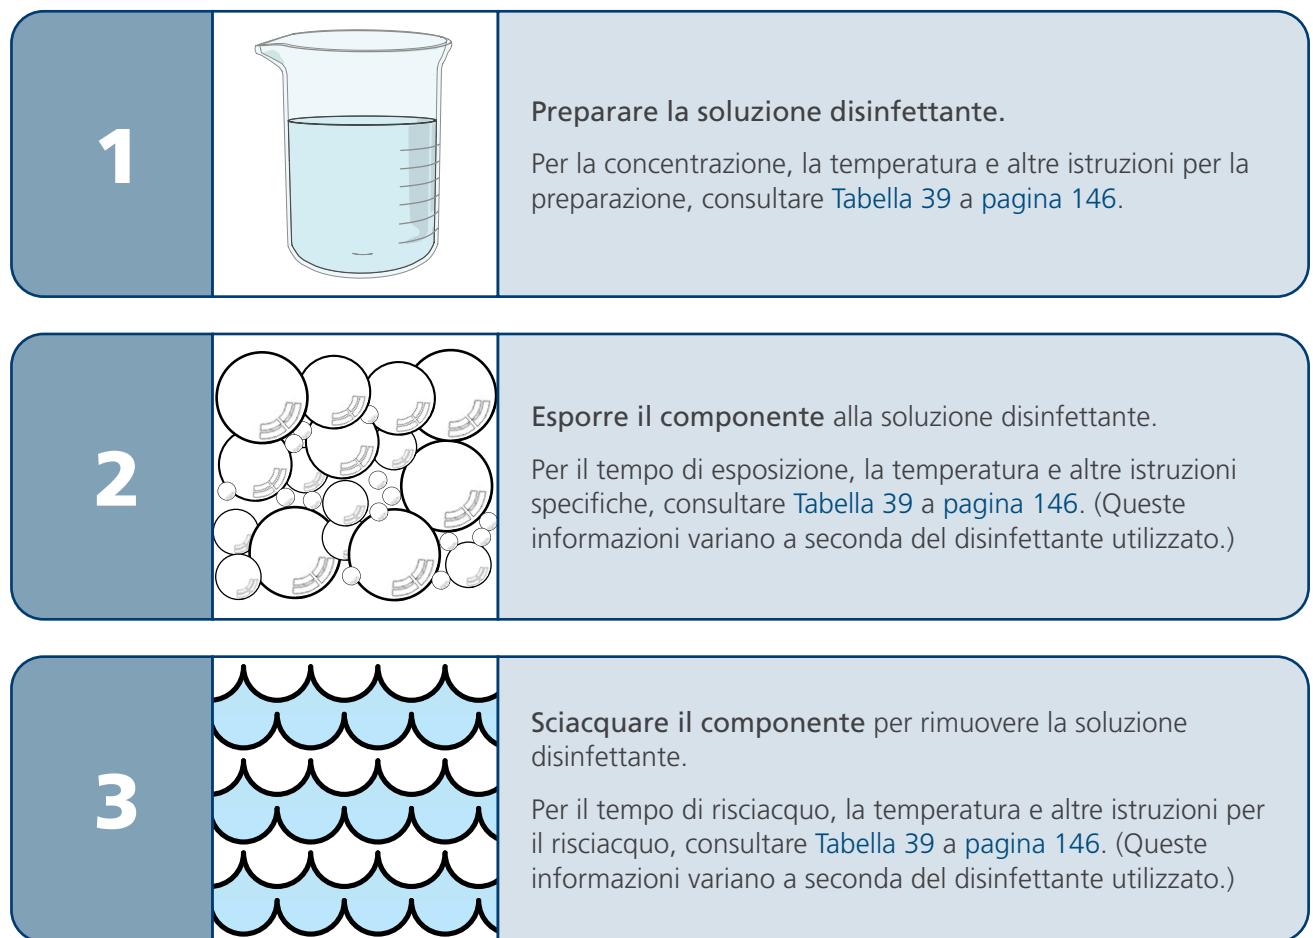



**4**




**Asciugare il componente.**

Utilizzare aria pulita di tipo ospedaliero per soffiare via l'umidità residua dai connettori, quindi asciugare il componente con uno dei metodi seguenti:

- aria pulita di tipo ospedaliero
- un panno pulito che non lascia pelucchi

**5**




**Esaminare il componente** per accertarsi che non sia danneggiato.


Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura.

Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.

**6**



**Conservare il componente** in un ambiente pulito.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (PRODOTTI LIQUIDI)

Verathon ha convalidato la compatibilità chimica e l'efficacia biologica dei prodotti nella [Tabella 39](#) per la disinfezione dei componenti indicati secondo le istruzioni elencate nella colonna Condizioni.

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

### IMPORTANTE

Quando si effettua una disinfezione ad alto livello su un cavo video o Smart Cable, si può utilizzare un sistema Cantel (MEDIVATORS) CER Optima 1 & 2 AER, DSD-201 AER o SSD-102 AER, a condizione che vengano rispettati i requisiti riportati di seguito:

- Utilizzare uno dei disinfettanti ad alto livello di disinfezione indicati nella [Tabella 39](#).
- Utilizzare un disinfettante compatibile con il sistema Cantel. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità chimica, contattare Cantel.
- Seguire le condizioni di condizionamento fornite nella [Tabella 39](#), tra cui temperatura, esposizione e concentrazione per il prodotto disinfettante che si intende utilizzare.
- Non esporre il componente a temperature superiori a 60 °C (140 °F) durante i cicli.

Nella tabella seguente, con il termine *acqua distillata* si intende il tipo di acqua idoneo alla disinfezione, in conformità alle normative locali e al regolamento della struttura sanitaria in cui si opera.

*Tabella 39. Soluzioni disinfettanti per cavi video e Smart Cables*

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
STERIS S40 o S20	Alto	Cavo video Titanium	600	Utilizzare i cicli standard nei seguenti processori: SYSTEM 1E (negli Stati Uniti) STERIS SYSTEM 1 (fuori dagli Stati Uniti) SYSTEM 1 EXPRESS (fuori dagli Stati Uniti) SYSTEM 1 PLUS (fuori dagli Stati Uniti)
		Spectrum Smart Cable	750	<b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>



Tabella 39. Soluzioni disinfezianti per cavi video e Smart Cables

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
STERIS Resert XL HLD <sup>†</sup> Revital-Ox Resert XL HLD <sup>†</sup> Revital-Ox Resert HLD/ Chemosterilant <sup>‡</sup>	Alto	Cavo video Titanium	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 8 minuti, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente una volta per 1 minuto in acqua distillata, mantenendolo in agitazione. Verificare che il connettore sia stato risciacquato correttamente.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Disinfettante OPA ASP CIDEX	Alto	Cavo video Titanium	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 10 minuti, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria. Utilizzare la soluzione alla massima concentrazione.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
		Spectrum Smart Cable	1.500	
		Cavo video Core	1.500	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 12 minuti, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria. Usare la soluzione alla concentrazione massima, dopo averla verificata con strisce CIDEX OPA.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione. Usare un lotto fresco di acqua distillata per ogni immersione.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
		Core Smart Cable	1.500	
Metrex MetriCide OPA Plus	Alto	Cavo video Titanium	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 10 minuti, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria.</p> <p><b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
		Spectrum Smart Cable	1.500	




Tabella 39. Soluzioni disinfezianti per cavi video e Smart Cables

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Cantel (MEDIVATORS) Rapicide OPA/28	Alto	Cavo video Titanium	3.000	<b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 10 minuti, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria. <b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione. <b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
		Spectrum Smart Cable	1.500	
Anios OPASTER'ANIOS/ Farmec OPASTER	Alto	Cavo video Titanium	3.000	<b>Esposizione:</b> immergere il componente per 30 minuti a temperatura ambiente, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria. Utilizzare la soluzione alla massima concentrazione. <b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione. Accertarsi che tutti i connettori esposti siano sciacquati correttamente. <b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
		Spectrum Smart Cable	1.500	
	Alto	Cavo video Core	1.500	<b>Esposizione:</b> immergere il componente a una temperatura di 20 °C (68 °F) o superiore per 12 minuti, accertandosi che sulla superficie non rimangano bollicine d'aria. Usare la soluzione alla concentrazione massima, dopo averla verificata con strisce CIDEX OPA. <b>Risciacquo:</b> immergere il componente in acqua distillata per 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, mantenendolo in agitazione. Accertarsi che tutti i connettori esposti siano sciacquati correttamente. <b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
		Core Smart Cable	1.500	



Tabella 39. Soluzioni disinfeettanti per cavi video e Smart Cables

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Metrex MetriCide 28 <sup>†</sup>	Alto	Cavo video Titanium	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente per 20 minuti a 25 °C (77 °F), accertandosi che sulla sua superficie non rimangano bollicine d'aria.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente in acqua distillata a 33–40 °C (91–104 °F). Immergerlo 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, durante il quale lo si agita, lo si sciacqua e lo si strofina con una spazzola sterile a setole morbide.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Sultan Healthcare Sporox II	Alto	Cavo video Titanium	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente per 30 minuti a 20 °C (68 °F), accertandosi che sulla sua superficie non rimangano bollicine d'aria. Trascorsi i 30 minuti di immersione, sciacquare i connettori e altri recessi sul componente, quindi spazzolare il componente con una spazzola sterile con setole morbide. Dopo aver sciacquato e spazzolato il componente, immergerlo per altri 30 minuti.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente in acqua distillata a 33–40 °C (91–104 °F). Immergerlo 3 volte, ciascuna volta per 3 minuti, durante i quali lo si sciacqua e lo si strofina con una spazzola sterile a setole morbide.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>




Tabella 39. Soluzioni disinfettanti per cavi video e Smart Cables

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Soluzione dialdeide attivata (ADS) ASP CIDEX	Alto	Cavo video Titanium	3.000	<p><b>Esposizione:</b> immergere il componente per 45 minuti a 25 °C (77 °F), accertandosi che sulla sua superficie non rimangano bollicine d'aria.</p> <p><b>Sciacquare</b> il componente in acqua distillata a 33–40 °C (91–104 °F). Immergerlo 3 volte, ciascuna volta per 1 minuto, durante il quale lo si agita, lo si sciacqua e lo si strofina con una spazzola sterile a setole morbide.</p> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
Cantel (MEDIVATORS) Rapicide PA 30 °C	Alto	Cavo video Titanium	100	<p><b>Concentrazione:</b> <math>850 \pm 100</math> parti per milione</p> <p><b>Esposizione:</b> condizionare il componente per 5 minuti a 30 °C (86 °F) in un sistema Cantel Advantage Plus o DSD Edge AER con la configurazione seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Collegamento: 2-8-002HAN Rev. B</li><li>• Parametro: 1-24-010 C DISF</li></ul> <p><b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b></p>
		Spectrum Smart Cable	100	


\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.

† Questo prodotto chimico può causare lo scolorimento dei componenti in metallo. Tuttavia, questo effetto non influenza sulla funzionalità o l'efficacia del sistema.




## DISINFEZIONE DI UN CAVO VIDEO O SMART CABLE (CON SALVIETTE)

1




Pulire il componente strofinandolo con le salviette.  
Strofinare nuovamente il componente con le salviette  
ogniqualvolta sia necessario per mantenerlo visibilmente  
bagnato durante tutto il periodo di esposizione. Utilizzare  
tutte le salviette necessarie.  
Per istruzioni specifiche, consultare [Tabella 40 a pagina 152](#).  
(Queste informazioni variano a seconda delle  
salviette utilizzate.)

2




Sciacquare il componente per rimuovere ogni residuo  
di disinfettante, se necessario.  
Per stabilire se con le salviette utilizzate è necessario  
procedere al risciacquo, consultare la [Tabella 40](#)  
a [pagina 152](#).

3




Asciugare il componente.  
Lasciarlo asciugare bene all'aria.

4




Esaminare il componente per accertarsi che non  
sia danneggiato.  
Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati  
parte della normale usura.  
Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il  
componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.

5



Conservare il componente in un ambiente pulito.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO (SALVIETTE)

Verathon ha convalidato la compatibilità chimica e l'efficacia biologica dei prodotti nella **Tabella 40** per la disinfezione dei componenti indicati secondo le istruzioni elencate nella colonna Condizioni.

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).

Tabella 40. Salviette disinfettanti per cavi video e Smart Cables


PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviette germicide usa e getta PDI Sani-Cloth Bleach	Basso	Cavo video Titanium	1.500	<b>Esposizione:</b> con una salvietta nuova, rimuovere tutto lo sporco ostinato visibile, quindi con altre salviette nuove inumidire tutte le superfici del componente. Usare altre salviette nella misura necessaria per mantenere il componente visibilmente bagnato per 4 minuti. <b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria. <b>↳ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
		Spectrum Smart Cable	1.500	
Salviettine germicide AF3 usa e getta PDI Sani-Cloth	Basso	Cavo video Titanium	3.000	<b>Esposizione:</b> Bagnare tutte le superfici del componente e mantenerle bagnate per 3 minuti. <b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria. <b>↳ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
		Spectrum Smart Cable	1.500	
		Cavo video Core	1.500	
		Core Smart Cable	1.500	



Tabella 40. Salviette disinfettanti per cavi video e Smart Cables

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
Salviette universali Clinell	Basso	Cavo video Titanium	3.000	<b>Esposizione:</b> Bagnare tutte le superfici del componente e mantenerle bagnate per 6 minuti. <b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria.
		Spectrum Smart Cable	1.500	<b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
Salviette germicide alla candeggina Clorox	Basso	Cavo video Titanium	3.000	<b>Esposizione:</b> bagnare tutte le superfici del componente e mantenerle bagnate per 3 minuti. <b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria.
		Spectrum Smart Cable	1.500	<b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
Metrex CaviWipes1	Basso	Cavo video Titanium	3.000	<b>Esposizione:</b> bagnare tutte le superfici del componente e mantenerle bagnate per 1 minuto. <b>Asciugatura:</b> lasciare asciugare bene il componente all'aria.
		Spectrum Smart Cable	1.500	<b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
Sistema di salviette Tristel Trio	Alto	Cavo video Titanium	3.000	<b>Esposizione:</b> eseguire 2 applicazioni della schiuma attivatore su una salvietta sporicida e manipolarla per 15 secondi. Bagnare tutte le superfici del componente e lasciare agire per 30 secondi. <b>Risciacquo:</b> utilizzare una salvietta per il risciacquo per pulire tutte le superfici del componente.
		Spectrum Smart Cable	1.500	<b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.



## PROCEDURA 4. STERILIZZAZIONE DI UN CAVO VIDEO O SMART CABLE (FACOLTATIVA)



### AVVERTENZA

Accertarsi che ogni componente sia completamente pulito, prima di disinfeccarlo o sterilizzarlo. Se non lo è, la procedura di disinfezione o sterilizzazione potrebbe non rimuovere tutti gli agenti contaminanti, con conseguente aumento del rischio di infezione.



### ATTENZIONE

Non esporre il componente del sistema GlideScope a temperature superiori a 60 °C (140 °F), né utilizzare autoclavi o altri sistemi di sterilizzazione termici diversi da quelli descritti nel presente manuale. L'esposizione a calore eccessivo danneggia irreparabilmente il dispositivo e comporta l'annullamento della garanzia.



Leggere la sezione [Avvertenze e precauzioni](#) prima di eseguire le operazioni seguenti.

La sterilizzazione del cavo video o Smart Cable è facoltativa. Tuttavia, è possibile che la struttura sanitaria o il fornitore richiedano la sterilizzazione dei componenti in questione prima dell'utilizzo. Per la sterilizzazione di un cavo video o di uno Smart Cable attenersi alla procedura descritta di seguito.

### PRIMA DI INIZIARE


Prima di iniziare la procedura di sterilizzazione del componente, assicurarsi di svolgere le seguenti azioni:

- Pulire il componente secondo le istruzioni e gli standard descritti nella sezione precedente, [Pulizia di un cavo video o Smart Cable](#).
- Al termine della pulizia, ispezionare il componente come descritto nella sezione [Pulizia di un cavo video o Smart Cable](#). Se si riscontrano danni che superano la normale usura, non riutilizzarlo e contattare l'Assistenza clienti Verathon.
- Non cercare di applicare un cappuccio protettivo sui connettori dei cavi video o Smart Cables. Questi componenti sono progettati per essere sterilizzati senza l'utilizzo di cappucci protettivi, che Verathon peraltro non fornisce.



## STERILIZZAZIONE DI UN CAVO VIDEO O SMART CABLE


**1**



Confezionare il componente in una busta, materiale avvolgente o altro contenitore, se opportuno.

Per il tipo di confezionamento opportuno per il sistema di sterilizzazione in uso, fare riferimento alle istruzioni del produttore e alla [Tabella 41 a pagina 157](#).


**2**



Sterilizzare il componente.

Per le impostazioni del ciclo compatibile e altre informazioni specifiche, fare riferimento alla [Tabella 41 a pagina 157](#). Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni del produttore del sistema di sterilizzazione.

**3**




Esaminare il componente per accertarsi che non sia danneggiato.


Scolorimento del metallo e graffi minori sono considerati parte della normale usura.

Se si rileva qualsiasi danno effettivo, non utilizzare il componente. Contattare l'Assistenza clienti Verathon.

**4**



Conservare il componente in un ambiente idoneo per apparecchiature sterili.



## INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO

Verathon ha convalidato la compatibilità chimica e l'efficacia biologica dei prodotti specificati in questa tabella per la sterilizzazione dei componenti indicati secondo le istruzioni elencate nella colonna Condizioni.

### IMPORTANTE

Concentrazioni, temperature, tempi e istruzioni specifiche indicati nella tabella seguenti sono basati sui test eseguiti da Verathon. Se queste informazioni differiscono dalle istruzioni del produttore del prodotto di ricondizionamento utilizzato, attenersi alle informazioni della tabella.

### IMPORTANTE

Per un elenco completo dei prodotti di ricondizionamento compatibili, fare riferimento alla tabella alla pagina [verathon.com/glidescope\\_reprocessingproducts](http://verathon.com/glidescope_reprocessingproducts).



Tabella 41. Prodotti per la sterilizzazione di cavi video e Smart Cables

PRODOTTO	LIVELLO DI DISINFEZIONE	COMPONENTE	CICLI*	CONDIZIONI
STERIS S40 o S20	Sterilizzazione	Cavo video Titanium	600	Utilizzare i cicli standard nei seguenti processori: SYSTEM 1E (negli Stati Uniti) STERIS SYSTEM 1 (fuori dagli Stati Uniti) SYSTEM 1 EXPRESS (fuori dagli Stati Uniti) SYSTEM 1 PLUS (fuori dagli Stati Uniti) Non è necessario il confezionamento. <b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
		Spectrum Smart Cable	750	
Sistemi STERIS V-PRO con Vaprox HC	Sterilizzazione	Cavo video Titanium	125	Inserire il componente in una busta Tyvek, quindi attivare il ciclo non-lumen in uno dei sistemi di sterilizzazione a bassa temperatura STERIS Amsco V-PRO. <b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
		Spectrum Smart Cable	100	
Sterilizzatore al perossido di idrogeno Gas Plasma ASP	Sterilizzazione	Cavo video Titanium	125	Inserire il componente in una busta Tyvek, quindi sterilizzarlo in uno dei seguenti processori: STERRAD 100S (per gli Stati Uniti) STERRAD 100S ciclo corto (fuori dagli Stati Uniti) STERRAD NX ciclo standard STERRAD 100NX ciclo standard STERRAD 50 STERRAD 200 ciclo corto <b>◀ Tornare alla procedura descritta in precedenza e completare i passaggi rimanenti.</b>
		Spectrum Smart Cable	100	

\* Il valore indica il numero di cicli di compatibilità testati sul componente. Superare il numero di cicli consigliato può compromettere la durata potenziale del prodotto.

# GLOSSARIO

---

Le seguenti tabelle forniscono definizioni dei termini specifici utilizzati nel manuale o sul prodotto stesso. Per avere un elenco completo di avvertenze, precauzioni e simboli internazionali usati su questo e altri prodotti Verathon consultare i pittogrammi Verathon all'indirizzo [verathon.com/symbols](http://verathon.com/symbols).

TERMINE	DEFINIZIONE
AER	Rigeneratore automatico di endoscopi
C	Celsius
CFR	Code of Federal Regulations (USA)
cm	Centimetro
CSA	Canadian Standards Association
F	Fahrenheit
g	Grammo
HDMI	High-definition multimedia interface (interfaccia multimediale ad alta definizione)
hPa	Ettopascal
IPA	Alcol isopropilico
ISO	International Standards Organization
kPa	Kilopascal
l	Litro
lb	Libbra
LD	Laringoscopia diretta
m	Metro
MDD (DDM)	Direttiva sui dispositivi medici
ml	Millilitro
mm	Millimetro
mmHg	Millimetri di mercurio
MSDS	Scheda di sicurezza
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (agenzia federale statunitense)
pol.	Pollice
Prestazioni essenziali	Le prestazioni di sistema necessarie per evitare rischi inaccettabili
psia	Pounds per square inch absolute (libbre per pollice quadrato)
ricondizionamento	Preparazione di un componente riutilizzabile per l'utilizzo successivo. Il ricondizionamento comprende pulizia, disinfezione e sterilizzazione come opportuno.
SDS	Sodio dodecilsolfato
UR	Umidità relativa



